

# Fournitures de soins de plaies du CISSS des Laurentides

2018



Équipe des conseillères en soins de plaies  
DSIEC



## Table des matières

<b>TABLEAU SYNTHÈSE DES PANSEMENTS ACCESSIBLES DANS LE CISSS DES LAURENTIDES</b> .....	3
PROTECTEURS CUTANÉS LIQUIDES .....	4
PROTECTEURS CUTANÉS EN CRÈME (BARRIÈRE CUTANÉE) ♣ .....	5
PELLICULES ADHÉSIVES TRANSPARENTES.....	6
RUBAN DE FIXATION ADHÉSIF EXTENSIBLE (MEFIX) .....	7
HYDROGEL ♣ .....	8
PANSEMENTS HYDROCOLLOÏDES ♣♣.....	9
PANSEMENT HYDROPHILE ♣♣ .....	10
PANSEMENT ABSORBANT : HYPERTONIQUE ♣♣ .....	11
PANSEMENT ABSORBANT : MOUSSE HYDROCELLULAIRE ♣♣♣.....	12
PANSEMENT ABSORBANT : ALGINATE DE CALCIUM ♣♣♣ .....	13
PANSEMENT ABSORBANT : HYDROFIBRE ♣♣♣♣.....	14
PANSEMENT ABSORBANT : ACRYLIQUE ♣♣♣.....	15
PANSEMENTS NON ADHÉRENTS SEMI-PERMÉABLES NON IMPRÉGNÉS ♣ .....	16
PANSEMENTS NON ADHÉRANT IMPRÉGNÉS .....	17
PANSEMENTS NON ADHÉRANT IMPRÉGNÉS D’AGENTS ANTIMICROBIENS .....	18
PANSEMENTS AU CHARBON (ANTI-ODEUR) ♣♣.....	19
PRODUITS ANTIMICROBIEN À BASE DE SULFADIAZINE D’ARGENT.....	20
PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE CADEXOMÈRE D’IODE ♣ .....	21
PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D’ARGENT : NANOCRISTALLIN .....	22
PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D’ARGENT : MOUSSE HYDROCELLULAIRE ♣♣♣.....	23
PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D’ARGENT : ALGINATE ♣♣♣ .....	24

PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D'ARGENT : HYDROFIBRE ●●●●	25
PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE VIOLET DE GENTIANE ET BLEU DE MÉTHYLÈNE ●●●	26
PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE PHMB (Polyhexaméthylène Biguanide) ● et +	27
NITRATE D'ARGENT (AgNO <sub>3</sub> )	28
AGENT DE DÉBRIDEMENT ENZYMATIQUE	29
BIOMATÉRIAUX : PROMOGRAN PRISMA	30
BANDAGE COMPRESSIF ÉLASTIQUE MULTICOUCHES - SUREPRESS	31
BANDAGE COMPRESSIF À COURTE ÉLASTICITÉ – COBAN 2 et COBAN 2 LITE	32
BANDAGE COMPRESSIF TUBULAIRE 1 COUCHE : ELASTIGRIP	33
PANSEMENT POST-OPÉRATOIRE ●●●	34
ANNEXE : Notices des compagnies	35
GRM NON STANDARDISÉS (À VENIR)	63

LÉGENDE D'EXSUDAT	
● faible	●●● abondant
●● modéré	●●●● très abondant



Solutions de nettoyage de plaies		
Bouteille de NaCl 0,9% à usage unique 100ml (réservé pour le CLSC)	GRM : 42046542	Prix :\$
Bouteille eau stérile à usage unique 100ml (réservé pour le CLSC)	GRM : 42046544	Prix :\$

Charte des prix		
\$ = 0\$ à 1\$	\$\$ = 1\$ à 4\$	\$\$\$ = 5\$ et plus


## TABLEAU SYNTHÈSE DES PANSEMENTS ACCESSIBLES DANS LE CISSS DES LAURENTIDES

	Prévenir et traiter l'irritation cutanée	Niveau d'absorption					Contrôle la charge microbienne	Maintien l'humidité	Favorise le débridement autolytique	Non adhérent	Propriété hémostatique	Comblent l'espace mort	Réduit les odeurs	Régulateur de l'activité protéasique	Marques commerciales (Produits disponibles au CISSS des Laurentides)
		Aucune absorption	●	●●	●●●	●●●●									
Protecteurs cutanés liquides	✓	✓													Skinprep No-sting / Cavilon
Protecteurs cutanés crème	✓	✓													Critic Aid Clear
Pellicule transparente	✓	✓					✓	✓							Opsite Flexigrid
Hydrogel		✓					✓	✓			✓				Intrasite gel
Hydrocolloïde	✓			✓			✓	✓							Tegaderm Hydrocolloïd, Duoderm extra mince
Pâte hydrophile				✓			✓	✓			✓				Triad
Pansements absorbants	Hypertonique			✓		✓		✓			✓				Mesalt
	Mousse hydrocellulaire à base de Silicone				✓		✓	✓	✓						Mepilex, Mepilex Border, Mepilex Sacrum
	Alginate de calcium				✓		✓	✓		✓	✓				Alginate de calcium Kendall
	Hydrofibre					✓	✓	✓			✓				Aquacel Extra
	Pansement Acrylique				✓		✓	✓							Tegaderm Acrylique Absorbant
Non adhérent, non imprégné			✓				✓		✓						Telfa
Non adhérent, imprégné		✓					✓		✓						Adaptic, Adaptic Touch
Pansements antimicrobiens	Non adhérent, imprégné d'agent antimicrobien	✓				✓	✓		✓						Bactigras
	Pansement au charbon (anti-odeur)			✓		✓					✓	✓			Actisorb Silver
	Sulfadiazine d'argent	✓				✓									Flamazine
	Cadexomère d'iode		✓			✓	✓	✓			✓				Iodosorb
	Argent nanocristallin	✓				✓									Acticoat Flex 3
	Mousse hydrocellulaire avec argent				✓	✓	✓	✓							Mepilex Border AG
	Alginate avec argent				✓	✓	✓	✓		✓	✓				Silvercel
	Hydrofibre avec l'argent					✓	✓	✓	✓		✓				Aquacel Ag+ Extra
	Violet de gentiane et bleu de méthylène					✓	✓	✓	✓		✓				Hydrofera Blue Classic
	PHMB (Polyhexaméthylène biguanide) Plusieurs formes		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓				Mousse, rouleau, compresse, mèche
Nitrate d'Argent		✓				✓				✓				Bâtonnet nitrate d'argent	
Bioactif (avec argent)						✓				✓		✓		Promogran Prisma	

## PROTECTEURS CUTANÉS LIQUIDES



NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>SKIN-PREP NO-STING®</b> «Smith &amp;Nephew» Stérile</p> 	<p><b>PRIX :</b> \$ Par sachet</p> <p><b>GRM :</b> 42046590</p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agir comme une barrière contre l'humidité</li> <li>• Augmenter l'adhérence du pansement et prévient les traumatismes lors de son retrait</li> <li>• Réduit les risques d'irritation associés aux forces de frottement</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer le produit au pourtour de la plaie sur toute la région à protéger</li> <li>• Laisser sécher <b>environ 30 secondes</b></li> <li>• Si l'application se fait avec le vaporisateur, tenir la bouteille de 10 à 15 cm de la plaie et vaporiser en couche mince</li> <li>• Usage unique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Éviter la région près des yeux</li> </ul>
<p><b>CAVILON®</b> «3 M» Stérile <i>Pour certains cathéters centraux ou en cas d'allergie ou Skin-Prep No-Sting</i></p> 	<p><b>PRIX :</b> \$\$ Par bâton applicateur</p> <p><b>GRM :</b> 42046591</p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pourtour d'une plaie exsudative</li> <li>• Pourtour d'un drain</li> <li>• Pourtour d'une stomie au besoin</li> <li>• Pourtour d'une plaie traitée avec : un agent hydratant, un agent de débridement ou un pansement rétenteur d'humidité</li> <li>• Dermate de contact</li> </ul>	<p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stérile</b></li> <li>• Ne pas frotter pour essayer d'enlever le produit, car il est imperméable à l'eau</li> <li>• Se résorbe naturellement après 72 heures. Il se dissout avec du savon ou se retire avec un ruban adhésif</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfection q 48 à 72 heures ou selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	

## PROTECTEURS CUTANÉS EN CRÈME (BARRIÈRE CUTANÉE) 📌


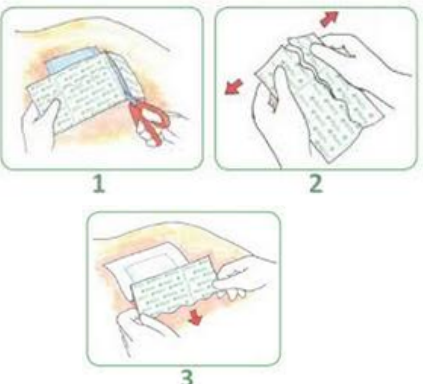
NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>CRITIC-AID CLEAR®</b> «Coloplast»</p> <p><i>Composé de gelée de pétrole 71.5%, gomme de cellulose, diméthicone, acétate de tocophérol, oxyde de zinc</i></p> 	<p><u>SACHET 4g</u> <u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046565 (4g)</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p><u>TUBE 71g</u> <u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046543 (71g)</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protéger la peau contre l'irritation en créant une barrière contre l'humidité causée par l'urine, les selles ou les drainages enzymatiques</li> <li>Prévenir, soulager et traiter l'érythème fessier</li> <li>Traiter une plaie superficielle (perte d'épiderme) au siège</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peau fragile</li> <li>Traitement d'une peau irritée par les liquides biologiques</li> <li>Traitement d'une dermatite de contact</li> <li>Pourtour d'un drain</li> <li>Traitement d'une plaie superficielle avec perte d'épiderme</li> <li>Prévention de l'érythème fessier chez la personne présentant des diarrhées</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la peau puis assécher en l'épongeant</li> <li>Enduire le produit en <b>couche mince</b> sur la région à protéger, sans tenter de faire pénétrer la crème</li> <li>Pour les incontinences : nettoyer avec un nettoyant cutané (ex. : Tena ou « Sproam ») avant de réappliquer le produit : <u>se référer au protocole de soin de la peau</u></li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être appliqué par-dessus un antifongique ou une crème d'hydrocortisone. La peau doit avoir été préalablement complètement nettoyée avant l'application. Réévaluer quotidiennement et cesser si absence d'amélioration après 3 jours.</li> <li>Peut nuire à l'adhérence du pansement</li> <li>Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Après chaque soin d'incontinence ou selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie ou sensibilité</li> <li>Infection non traitée</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.36


## PELLICULES ADHÉSIVES TRANSPARENTES

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>TÉGADERM®</b> «3M»</p> <p>Stérile Composé d'un film de polyuréthane</p> 	<p>4 x 4cm <b>GRM</b> : 42046589</p> <p>6 x 6cm <b>GRM</b> : 42046587</p> <p>10 x 12,5cm <b>GRM</b> : 42046586</p> <p>15 x 20cm <b>GRM</b> : 42046588</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir la plaie humide pour favoriser la cicatrisation</li> <li>Protéger la plaie de la friction et du cisaillement</li> <li>Créer une barrière contre les contaminants (imperméable aux liquides et bactéries)</li> <li>Favoriser le débridement autolytique</li> <li>Fixer le pansement primaire ou ses contours seulement</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaie superficielle peu exsudative telle que brûlure 1er ou 2e degré, laceration et abrasion</li> <li>Plaie de pression de stade 1</li> <li>Site donneur de greffe cutanée</li> <li>Pour couvrir une phlyctène</li> <li>Plaie chirurgicale</li> <li>Prévention des lésions de pression</li> <li>En prévention sur une plaie nouvellement épithélialisée</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>Appliquer un protecteur cutané au besoin. Choisir un format de 3 cm plus grand que la plaie</li> <li>Utiliser comme un pansement primaire ou secondaire.</li> <li>Le retirer en parallèle pour éviter les traumatismes</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune capacité d'absorption</li> <li>Imperméable aux liquides et aux bactéries</li> <li>Perméable à la vapeur d'eau et aux gaz</li> <li>Peut permettre à l'usager de prendre une douche sans mouiller le pansement</li> <li>Permet de visualiser la plaie</li> <li>Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours + PRN et selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie ou sensibilité connue aux adhésifs</li> <li>Peau macérée</li> <li>Plaie exsudative</li> <li>Plaie infectée <u>non traitée</u></li> </ul>
	<p><b>PRIX :</b> \$</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p> <p>Sans latex</p>			<p><b>Autres possibilité de pellicule transparente (Rouleau)</b></p> <p><b>Hypafix transparent / BSN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rouleau 5cm x 10mètres GRM : 42046585</li> <li>Rouleau 10cm x 10mètres GRM : 42046584</li> </ul> 



## RUBAN DE FIXATION ADHÉSIF EXTENSIBLE (MEFIX)

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p style="text-align: center;"><b>MEFIX</b> «Mölnlycke»</p> <p><i>Adhésif extensible en rouleau</i></p> 	<p><b>PRIX :</b> \$\$</p> <p><b>GRM :</b> La plus courante : <u>10cm x 10m 42046592</u></p> <p>2,5cm x 10m 42046594 5cm x 10m 42046596 15cm x 10m 42046593 20cm x 10m 42046595</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p> <p><b>Sans latex</b></p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation adhésive</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisé pour fixer les pansements, les compresses, les cathéters et les tubulures, et dans de nombreuses situations nécessitant une fixation.</li> </ul>	<p><b>Instruction :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Découper la longueur appropriée.</li> <li>2. Séparer les deux parties du papier de protection en tirant et en courbant légèrement le dispositif. Retirez la partie étroite.</li> <li>3. Appliquez la partie dont la surface adhésive est sur la peau. Retirez le papier de protection restant. Lisser fermement pour obtenir une bonne adhérence. Ne pas étirer lors de l'application.</li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchirure cutanée ou usager à risque de déchirure cutanée</li> <li>• Réaction allergique au produit</li> <li>• Ne pas appliquer en pansement primaire directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Ne pas appliquer le produit sous tension</li> </ul>


## HYDROGEL

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>INTRASITE GEL®</b> «Smith &amp; Nephew»</p> <p><i>Composé d'eau purifiée 77.7%, propylène glycol 20% et de structure de carboxyméthylcellulose 2.3%</i></p> 	<p>8g</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046545</p> <p><u>RAMQ</u> : En produit de base</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrater la plaie</li> <li>• Légèrement absorbant</li> <li>• Contribuer à combler un espace mort</li> <li>• Protéger les tissus de granulation</li> <li>• Favoriser la migration cellulaire et l'autolyse en réhydratant les tissus dévitalisés</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lésion de pression (stade 2 à 4 peu exsudative ou sèche)</li> <li>• Débridement autolytique</li> <li>• Ulcère de jambe peu exsudative ou sèche avec potentiel de cicatrisation</li> <li>• Plaie chirurgicale peu exsudative ou sèche</li> <li>• Plaie néoplasique avec potentiel de cicatrisation</li> <li>• Plaie infectée traitée (sous antibiothérapie)</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Nettoyer l'embout de l'applicateur avec de l'alcool avant de le casser</li> <li>• Mettre une couche mince d'environ 3 à 5 mm sur le lit de la plaie</li> <li>• Il est possible d'imbiber une mèche ou une compresse d'hydrogel pour combler une cavité ou un espace mort</li> <li>• Recouvrir la plaie d'un pansement mousse hydrocellulaire</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En présence de nécrose abondante, faire le changement de pansement DIE pour diminuer la charge microbienne</li> <li>• Si utilisé pour favoriser l'autolyse d'une escarre, scarifiée préalablement pour permettre la pénétration du gel</li> <li>• Peut causer de la macération, de l'hypergranulation ou favoriser une infection fongique si appliquée en trop grande quantité</li> <li>• Le gel se conserve 7 jours (recommandation de la compagnie) mais est à usage pour un seul patient</li> <li>• Inutile dans une plaie avec exsudat modéré à abondant</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 1 à 3 jours en phases inflammatoires et q 3 à 7 jours en phase proliférative, suite à l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité connue</li> <li>• Escarre stable et sèche sans potentiel de cicatrisation</li> <li>• Utiliser le produit avec précaution dans une plaie profonde, car le retrait du produit peut être difficile</li> <li>• Pour usage externe seulement</li> <li>• Plaie infectée <u>non traitée</u></li> </ul>

## PANSEMENTS HYDROCOLLOÏDES


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>TÉGADERM HYDROCOLLOÏD® «3M»</b></p> <p><i>Composé de gélatine, pectine, carboxy-méthylcellulose sodique, recouverte d'une pellicule polyuréthane</i></p> 	<p>10 x 12 cm Ovale avec bordures</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046565</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 101</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorber l'exsudat en se transformant en gel au contact de l'exsudat</li> <li>• Retenir l'humidité dans la plaie pour favoriser le débridement autolytique et la cicatrisation</li> <li>• Abaisser la tension d'oxygène dans la plaie pour favoriser l'angiogenèse ou formation de nouveaux vaisseaux</li> <li>• Protéger la peau contre les forces de frottement et de cisaillement</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Choisir un format de 3 cm plus grand que la plaie</li> <li>• S'assurer que l'hydrocolloïde épouse bien la forme du corps sans tractions sur la peau, ni bulles d'air sous le pansement</li> <li>• Lors du retrait, tirer de manière horizontale et parallèle à la peau afin de casser la matrice hydrocolloïde</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit un gel visqueux parfois nauséabond et épais qui masque l'écoulement réel donc bien nettoyer la plaie avant de l'évaluer</li> <li>• Tendance à rouler sur les rebords (border avec une pellicule transparente ou une bande adhésive PRN)</li> <li>• L'utiliser comme premier choix pour les plaies superficielles</li> <li>• Risque de macération et l'hypergranulation</li> <li>• Mince (Duoderm Xmince): imperméable aux liquides et aux bactéries, mais perméable aux gaz ou au aux vapeurs d'eau</li> <li>• Épais (Tegaderm hydrocolloïde) totalement occlusif</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 3- 7 jours ou PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité connue</li> <li>• Ulcère artériel, escarre sèche</li> <li>• Plaie infectée <u>non traitée</u></li> <li>• Incompatible avec des antimicrobiens</li> <li>• Exposition des structures profondes (os, tendon)</li> <li>• Plaie sans potentiel de cicatrisation</li> </ul>
<p><b>DUODERM EXTRA MINCE® «Convatec»</b></p> <p><i>Composé de gélatine, pectine, carboxy-méthylcellulose sodique, recouverte d'une pellicule polyuréthane</i></p> 	<p>10x10 cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$</p> <p><u>GRM</u> : 42046566</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 101</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie avec exsudat faible à modéré</li> <li>• Lésion de pression stade 1 à 3</li> <li>• Ulcère de jambe (sauf ulcère artériel)</li> <li>• Abrasion</li> <li>• Brûlure du 1er et 2e degré</li> <li>• Site de donneur de greffe cutanée</li> <li>• Peau à risque ou présentant des signes de détérioration causé par la friction et le cisaillement</li> </ul>	<p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 3- 7 jours ou PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	

## PANSEMENT HYDROPHILE

NOMS COMMERCIAUX DU PRODUIT	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>TRIAD®</b> <b>«Coloplast»</b></p> <p>Composé de gelée de pétrole, CMC (carboxyméthylcellulose), diméthicone et oxyde de zinc</p> 	<p>Tube 71g</p> <p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046575</p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stimuler la cicatrisation en favorisant un milieu humide</li> <li>Favoriser le débridement autolytique</li> <li>Comblent une cavité</li> <li>Protéger les tissus de granulation</li> <li>Absorber l'exsudat de plaie ayant un exsudat de faible à modéré.</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lésions de pression de stades 2 et 3</li> <li>Ulcères veineux</li> <li>Lésions et blessures dermiques exsudatives</li> <li>Égratignures et plaies superficielles exsudatives</li> <li>Plaie dans les endroits difficile à panser (ex. : sacrum)</li> </ul>	<p><b>Instructions (Application par un professionnel)</b></p> <p><b>Débridement autolytique</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appliquez une couche de Triad® sur le tissu nécrotique et sur la région en périphérie de la plaie</li> <li>Appliquez l'épaisseur d'une pièce de dix cents</li> <li>Pour aider l'absorption du tissu nécrotique liquéfié, recouvrez Triad® d'un pansement secondaire absorbant, comme le pansement de mousse au besoin</li> </ol> <p><b>Plaies peu profondes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appliquez une couche de Triad® directement sur la plaie</li> <li>Appliquez l'épaisseur d'une pièce de dix cents</li> <li>Recouvrez Triad® d'un pansement secondaire tel qu'un pansement de mousse ou une compresse, au besoin</li> </ol> <p><b>Plaies profondes</b> (y compris celles avec cavité ou tunnellation)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Imprégnez une gaze de 10 x 10 cm ou une mèche de gaze à l'aide de Triad®</li> <li>Entassez librement la gaze dans la plaie et dans les zones avec cavité. Placez la gaze imprégnée de sorte qu'elle puisse être facilement retirée de la plaie</li> <li>Recouvrez Triad d'un pansement secondaire absorbant, comme le pansement de mousse</li> <li>Les pansements de gaze imprégnés sont généralement remplacés toutes les 24 heures ou selon les protocoles de soins de plaies existants</li> </ol> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sécuritaire pour la peau péri lésionnelle, ne cause pas de macération et ne l'assèche pas</li> <li>Convient pour une clientèle pédiatrique</li> <li>Adhère à la peau humide, suintante ou érodée</li> <li>Cesser si aucun exsudat</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La quantité d'exsudat dicte la fréquence des changements de pansements</li> <li>En général, aux 5 à 7 jours et PRN, nettoyer complètement et appliquer à nouveau, selon l'évaluation de l'infirmière</li> <li>Renouveler l'application après un soin d'hygiène ou incontinence</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie ou sensibilité</li> <li>Plaie exposant les structures profondes</li> <li>Plaie infectée non traitée</li> <li>Brûlure du 3<sup>ème</sup> degré</li> <li>Ulcère artériel</li> </ul>




Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.37

## PANSEMENT ABSORBANT : HYPERTONIQUE

NOMS COMMERCIAUX DU PRODUIT	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>MESALT®</b> «Mölnlycke»</p> <p><i>Composé de viscose/polyester non-tissé imprégné de chlorure de sodium</i></p> 	<p>Mèche de 2 cm x 100 cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046549</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 101</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorber l'exsudat en milieu hypertonique</li> <li>• Contribuer au nettoyage des plaies colonisées ou infectées et favorise l'autolyse des tissus dévitalisés</li> <li>• Réduire la charge microbienne de surface</li> <li>• Résorbe l'œdème et entraîne les débris dans le pansement</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Tailler le pansement hypertonique à la dimension du lit de la plaie (compresse)</li> <li>• Appliquer le pansement sec, ne pas le mouiller</li> <li>• Recouvrir la plaie d'un pansement secondaire absorbant, car le Mesalt® peut faire augmenter l'exsudat</li> <li>• La réfection doit être DIE</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut donner une sensation de picotements ou de brûlure dans la plaie</li> <li>• Peut causer sensation brûlure ou d'inconfort Si usager ressent toujours une sensation de brûlure après 1 heure, cesser le pansement</li> <li>• Aucune donnée sur l'usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection DIE à BID selon exsudat, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Structure osseuse, tendons, ligaments</li> <li>• Plaies sèches telles qu'une escarre ou faiblement exsudative</li> </ul>
	<p>10 x 10 cm compresses</p> <p><u>PRIX</u> : \$</p> <p><u>GRM</u> : 42046548</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 101</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaies produisant un exsudat modéré à abondant</li> <li>• Plaies fibrineuses en phase inflammatoire</li> <li>• Plaies colonisées ou infectées</li> </ul>		


Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.39

## PANSEMENT ABSORBANT : MOUSSE HYDROCELLULAIRE

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>MEPILEX régulier®</b> « Mölnlycke » Mousse hydrocellulaire micro-adhérente siliconée non bordée</p> 	<p>10x10cm <b>PRIX :</b> \$\$ <b>GRM :</b> 42046572 <b>RAMQ :</b> DE101</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorber verticalement l'exsudat jusqu'à 20 fois son poids sec</li> <li>• Maintenir la plaie dans un milieu humide contrôlé</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Choisir un format de 2 à 3 cm plus grand que la plaie.</li> <li>• <i>Mepilex régulier®</i> : Fixer uniquement le pourtour de la mousse avec un adhésif ou une pellicule transparente afin de ne pas nuire à la perméabilité aux vapeurs d'eau de la membrane externe</li> <li>• La partie collante doit être en contact (silicone) avec la plaie</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sans latex</b></li> <li>• Ne pas utiliser avec des agents oxydant (<i>Dakin®</i>) ou eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène)</li> <li>• Semi-perméable, imperméable à l'eau</li> <li>• La mousse siliconée autoadhésive est l'option à considérer pour les usagers qui ont des réactions cutanées aux bordures adhésives ou la peau fragilisée</li> <li>• <i>Mepilex Border®</i> : bordures de silicone Permet de décoller pour visualiser et de recoller par la suite Ne peut être découpé au centre, seulement la bordure de silicone pour permettre la superposition</li> <li>• <i>Mepilex Border sacrum®</i> peut être utilisé en prévention ou en traitement des lésions de pression au siège</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours ou avant PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Brûlure du troisième degré</li> <li>• Plaie infectée non traitée</li> </ul>
<p><b>MEPILEX BORDER®</b> « Mölnlycke » Mousse hydrocellulaire siliconée auto-fixant, bordée</p> 	<p>12.5 x 12.5 cm <b>PRIX :</b> \$\$ <b>GRM :</b> 42046570  7.5 x 7.5 cm <b>PRIX :</b> \$\$ <b>GRM :</b> 42046571 <b>RAMQ :</b> DE 101</p>	<p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie avec exsudat modéré à abondant</li> <li>• Plaie chronique ou aiguë</li> <li>• Pansement primaire ou secondaire</li> <li>• Plaie sous thérapie compressive (produit compressible, n'augmentant pas la pression sur la plaie)</li> <li>• Peau fragile, ex : réaction cutanée à l'adhésif, radiodermite, peau très mince à risque de déchirure cutanée</li> </ul>	<p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sans latex</b></li> <li>• Ne pas utiliser avec des agents oxydant (<i>Dakin®</i>) ou eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène)</li> <li>• Semi-perméable, imperméable à l'eau</li> <li>• La mousse siliconée autoadhésive est l'option à considérer pour les usagers qui ont des réactions cutanées aux bordures adhésives ou la peau fragilisée</li> <li>• <i>Mepilex Border®</i> : bordures de silicone Permet de décoller pour visualiser et de recoller par la suite Ne peut être découpé au centre, seulement la bordure de silicone pour permettre la superposition</li> <li>• <i>Mepilex Border sacrum®</i> peut être utilisé en prévention ou en traitement des lésions de pression au siège</li> </ul>	
<p><b>MEPILEX BORDER SACRUM®</b> « Mölnlycke » Mousse hydrocellulaire siliconée auto-fixant pour la région du sacrum, bordée</p> 	<p>Forme sacrum <b>PRIX :</b> \$\$\$ <b>GRM :</b> 16 x 20cm : 42046737 22 x 25cm : 42046738 <b>RAMQ :</b> DE 101</p>			


Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.41

## PANSEMENT ABSORBANT : ALGINATE DE CALCIUM



NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE- INDICATIONS
<p><b>ALGINATE DE CALCIUM</b> <b>/ KENDALL®</b></p> <p>«Covidien» Composé de fibres d'acide mannurinique</p> 	<p><b>10 x 10 cm</b></p> <p><b>PRIX :</b> \$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046564</p> <p><b>RAMQ :</b> DE 101</p> <p><b>Sans latex</b></p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorber l'exsudat en se transformant en un gel de consistance légère au contact de celui-ci</li> <li>• Maintien un milieu humide favorisant la cicatrisation</li> <li>• Favoriser l'hémostase</li> <li>• Combler une cavité</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie produisant exsudat modéré à abondant</li> <li>• Plaie chronique ou aiguë tel qu'escarre, ulcère de jambe, diabétique, ou une plaie postopératoire</li> <li>• Plaie cavitaire à combler</li> <li>• Lit de la plaie friable ou hémorragique</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Appliquer sec et directement dans la plaie</li> <li>• Laisser dépasser légèrement des bords de la plaie</li> <li>• Le produit peut être superposé en plusieurs couches</li> <li>• Le recouvrir d'un pansement secondaire ex : mousse hydrocellulaire</li> <li>• Ne pas compacter la plaie, car il augmente de volume en absorbant l'exsudat</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le pansement est asséché, l'humidifier avec NaCl 0,9% avant le retrait, afin de réduire les traumatismes et la douleur</li> <li>• S'applique et s'enlève facilement sur une plaie qui produit beaucoup d'exsudat</li> <li>• Bien nettoyer la plaie après le retrait du pansement, car celui-ci peut laisser des débris</li> <li>• Peut être utilisé sur une plaie infectée</li> <li>• S'assurer d'avoir un exsudat suffisant sinon risque d'assécher la plaie</li> <li>• Laisse une odeur de mer et une coloration brunâtre ou verdâtre donc bien nettoyer la plaie avant d'évaluer la plaie</li> <li>• Déconseillé dans un sinus ou tunnel dont on ne peut visualiser le fond, car il peut laisser des débris</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfection q 7 jours + PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Plaie sèche ou avec exsudat léger</li> <li>• Brûlure du 3<sup>ème</sup> degré</li> </ul>

PANSEMENT ABSORBANT : HYDROFIBRE




NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>AQUACEL®EXTRA</b> «Convatec»</p> <p>Composé de fibre de carboxyméthylcellulose sodique(CMC)</p> 	<p>10x10 cm</p> <p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046547</p> <p><b>RAMQ :</b> DE 101</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorber l'exsudat en se transformant en gel au contact de celui-ci</li> <li>• Maintien la plaie humide, car favorise cicatrisation</li> <li>• Retient les microorganismes dans ses fibres</li> <li>• Combler une cavité</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie produisant exsudat modéré à abondant</li> <li>• Plaie chronique ou aiguë</li> <li>• Plaie cavitaires à combler (peut se plier)</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Appliquer sec et directement dans la plaie</li> <li>• Faire dépasser de 2 cm en bordure de la plaie, car se rétracte lors de l'absorption d'exsudat</li> <li>• Au besoin, superposer plusieurs couches</li> <li>• Le recouvrir d'un pansement secondaire (ex : mousse hydrocellulaire)</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le pansement est asséché, l'humidifier avant le retrait afin de réduire traumatisme et douleur</li> <li>• Bien irriguer la plaie, après le retrait du pansement, car il peut laisser des débris</li> <li>• S'assurer d'avoir un exsudat suffisant sinon risque de dessécher la plaie</li> <li>• Peut-être plié ou découpé dans tous les sens</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> <li>• Déconseillé dans un sinus ou un tunnel dont on ne peut visualiser le fond, car il peut laisser des débris</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours + PRN selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Plaie sèche</li> </ul>

## PANSEMENT ABSORBANT : ACRYLIQUE



NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTION ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>TEGADERM® ACRYLIQUE</b> « 3M »</p> <p><i>Compresse en polymère acrylique transparente comprise entre une couche de film transparent et d'un film perforé avec adhésif polyacrylique hydrophile</i></p>  	<p>7.6 X 9.5cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046552</p> <p>11.1 X 12.7cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046551</p> <p><u>RAMQ</u> : Ø</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméable aux liquides et perméable aux gaz</li> <li>• Absorbe l'exsudat et le retient dans la couche d'acrylique</li> <li>• Permet l'inspection de la plaie, car le film est transparent</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie produisant un exsudat léger à modéré</li> <li>• Plaie peu profonde (ex : <b>déchirures cutanées</b>, ulcères de jambe, ulcères de pression stade 1 ou 2, éraflures, brûlures de premier et second degrés, sites ayant subi une greffe cutanée, lésions postopératoires et plaies chirurgicales)</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer le protecteur cutané stérile PRN en évitant d'en appliquer sous la compresse d'acrylique</li> <li>• Choisir la taille du pansement appropriée. La compresse d'acrylique doit dépasser la plaie d'environ 1cm</li> <li>• Tenir le pansement par les 2 languettes et déposer le milieu de la compresse sur la plaie sans étirer le pansement</li> <li>• Appuyer doucement sur le pansement en le lissant bien sur la plaie</li> <li>• Retirer lentement le cadre de papier et appuyer sur les côtés pour s'assurer de l'étanchéité</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité de superposer en retirant la pellicule transparente de celui du dessous</li> <li>• Si présence d'une cavité peu profonde ou saignement, on peut ajouter un alginate. À ce moment, la fréquence de changement du pansement doit être q 7 jours</li> <li>• Éviter de couper l'îlot central du pansement</li> <li>• La plaie peut sembler s'agrandir au début étant donné le nettoyage des tissus inutiles</li> <li>• Une bulle de liquide peut s'accumuler dans l'îlot d'acrylique, mais il se résorbe par la suite</li> <li>• Ne pas le couvrir, car nuirait à l'évaporation</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le pansement peut rester en place jusqu'à 21 jours selon évaluation de l'infirmière</li> <li>• Changement du pansement si : l'exsudat déborde hors de l'îlot d'acrylique, la pellicule transparente est roulé ou ne colle plus, il y a des signes cliniques d'infection</li> <li>• La plaie nécessite quand même une visualisation par l'infirmière</li> <li>• Peut être utilisé en post-opératoire d'une prothèse de genou ou de hanche. Le pansement peut rester en place jusqu'au retrait des agrafes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Plaie infectée</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.44

## PANSEMENTS NON ADHÉRENTS SEMI-PERMÉABLES NON IMPRÉGNÉS


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>TELFA®</b> <b>«Covidien»</b></p> <p>Composé de coton recouvert d'un film transparent perforé</p> 	<p>7,6 x 10,2 cm <b>8,9 x 20,3 cm</b></p> <p><u>PRIX</u> : \$</p> <p><u>GRM</u> : voir p.63</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurer une surface de contact non adhérent à la plaie</li> <li>• Semi-perméable</li> <li>• Absorber l'exsudat faiblement</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pansement primaire</li> <li>• Plaie peu exsudative</li> <li>• Ligne de suture</li> <li>• Lacération cutanée superficielle</li> <li>• Brûlure superficielle</li> <li>• Plaie aiguë ou chronique</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Choisir un format de 3 cm plus grand que la plaie</li> <li>• Recouvrir le pansement non-adhérent de compresses ou de coussinets abdominaux si l'on doit augmenter l'absorption du pansement</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessite un pansement secondaire pour le fixer et assurer l'étanchéité aux liquides afin de prévenir une contamination externe (ex. : <i>Opsite®</i> ou <i>Mefix®</i>)</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection DIE et PRN ou selon exsudat et évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Infection</li> </ul>

## PANSEMENTS NON ADHÉRANT IMPRÉGNÉS


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>ADAPTIC®</b> «Acelity (Systagenix)»</p> <p><i>Tricot d'acétate de cellulose à petites mailles imprégné de gelée de pétrole.</i></p> 	<p><b>7.5 X 7.5cm</b> <b>PRIX :</b> \$ <b>GRM :</b> 42046574</p> <p><b>7.5 X 20cm</b> <b>PRIX :</b> \$\$ <b>GRM :</b> 42046573</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p> <p><b>Absence de latex</b></p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurer une surface de contact non adhérente à la plaie</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchirures cutanées et lacérations</li> <li>• Plaies aiguës telle que chirurgicale, suturée, greffe, brûlure, abrasion, eczéma, plaies aux doigts</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Découper le pansement à la taille requise et le déposer directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Recouvrir d'un pansement secondaire absorbant selon le degré d'exsudat</li> <li>• Ne doit pas être plié ou superposé, car l'exsudat ne passera pas à travers les mailles et risque de causer de la macération ou de l'accumulation du fluide sous le pansement</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non traumatique au retrait du pansement</li> <li>• <i>Adaptic®</i> a tendance à sécher plus rapidement qu'<i>Adaptic Touch®</i> (silicone)</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> <li>• Permet l'application d'agent topique sans retrait du tulle</li> <li>• Il est recommandé d'utiliser un tulle à petite maille comme interface sur une structure exposée en dessous d'une mousse de thérapie à pression négative</li> <li>• <i>Adaptic®</i> : Incompatible avec les produits à l'argent, car contient de la gelée de pétrole</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfection q 1 à 7 jours selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> </ul>
<p><b>ADAPTIC TOUCH®</b> (silicone) «Acelity (Systagenix)»</p> <p><i>Composé d'un tricot de polyamide élastique à petites mailles enduit de gel de silicone</i></p> 	<p><b>7.5cm X 10cm</b> <b>PRIX :</b> \$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046567</p> <p><b>RAMQ :</b> DE 107</p> <p><b>Absence de latex</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaies douloureuses et traumatiques au retrait du pansement, peau fragilisée</li> <li>• Protection des structures profondes exposées (ex. : os, tendon) dans une plaie sous thérapie par pression négative</li> </ul>	<p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non traumatique au retrait du pansement</li> <li>• <i>Adaptic®</i> a tendance à sécher plus rapidement qu'<i>Adaptic Touch®</i> (silicone)</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> <li>• Permet l'application d'agent topique sans retrait du tulle</li> <li>• Il est recommandé d'utiliser un tulle à petite maille comme interface sur une structure exposée en dessous d'une mousse de thérapie à pression négative</li> <li>• <i>Adaptic®</i> : Incompatible avec les produits à l'argent, car contient de la gelée de pétrole</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfection q 1 à 7 jours selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	




## PANSEMENTS NON ADHÉRANT IMPRÉGNÉS D'AGENTS ANTIMICROBIENS

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>BACTIGRAS®</b> «Smith &amp; Nephew»</p> <p><i>Tulle à grande mailles imprégné d'acétate de chlorhexidine 0,5 % imprégné de vaseline</i></p> 	<p>5x5cm <u>PRIX</u> : \$</p> <p>10x10cm <u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : Pharmacie</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurer une surface de contact non adhérente à la plaie tout en contrôlant la charge microbienne de surface.</li> <li>• Efficace contre les Gram + et Gram -</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie aiguë telle que chirurgicale, site donneur ou receveur, brûlure mineure de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> degré, abrasion, laceration</li> <li>• Plaie à risque d'infection telle que plaie traumatique ou brûlure</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Découper le pansement à la taille requise et le déposer directement sur le lit de la plaie en couche unique de façon stérile</li> <li>• Recouvrir d'un pansement secondaire absorbant selon le degré d'exsudat</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laisse passer l'exsudat au travers des mailles</li> <li>• Ne doit pas être plié ou superposé</li> <li>• Ne pas l'utiliser pour recouvrir plus de 15% de la surface du corps chez l'adulte et 10% chez l'enfant</li> <li>• Réévaluer le traitement après 7 à 14 jours, car peut être cytotoxique pour les fibroblastes</li> <li>• Éviter le contact avec les yeux, l'oreille moyenne, méninge et cerveau</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfection recommandée DIE mais peut être laissé en place 2 à 4 jours selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité à la chlorhexidine</li> <li>• Incompatible avec les produits ioniques tels que l'argent</li> </ul>

## PANSEMENTS AU CHARBON (ANTI-ODEUR) 💧


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>ACTISORB SILVER®</b> «Acelity (Systagenix)»</p> <p><i>Composé de charbon actif recouvert d'une enveloppe de nylon et imprégné d'argent</i></p> 	<p>10,5 x 10,5 cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046538</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 106</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emprisonner les odeurs</li> <li>• Efficace en milieu humide ou sec</li> <li>• Contrôler la charge microbienne</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie malodorante</li> </ul> <p>Plaie colonisée ou infectée sous antibiothérapie</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0.9%</li> <li>• Assécher la peau en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Appliquer directement dans la plaie</li> <li>• Peut-être plié, plissé et roulé pour combler une cavité</li> <li>• Recouvrir d'un pansement secondaire absorbant selon le degré d'exsudat</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne jamais découper le pansement, car des morceaux de charbon pourraient s'en échapper</li> <li>• Non testé chez une clientèle pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours + PRN, lorsque l'odeur n'est plus absorbée, selon évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> </ul>

## PRODUITS ANTIMICROBIEN À BASE DE SULFADIAZINE D'ARGENT

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>FLAMAZINE®</b> «Smith&amp;Nephew»</p> <p><i>Composé de 1 % de sulfadiazine d'argent micronisée dans une émulsion pâteuse d'huile de paraffine dans l'eau</i></p> 	<p>50 g <u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p>500 gr <u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p><u>GRM</u> : Pharmacie</p> <p><u>RAMQ</u> : Couverture de base</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire la charge microbienne de surface</li> <li>• Traiter et prévenir l'infection par une action bactéricide à large spectre</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brûlure du 2<sup>ième</sup> et du 3<sup>ième</sup> degré</li> <li>• Plaie chronique colonisée ou infectée telle qu'ulcères veineux, artériels, diabétiques et lésions de pression</li> <li>• Site de donneur de greffes cutanées</li> <li>• Abrasion, coupure et autres lésions</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec eau stérile ou NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Appliquer une couche de 3 à 5 mm d'épaisseur de crème à base de sulfadiazine directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Recouvrir d'un pansement semi-perméable (ex. : Telfa®)</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servie par la pharmacie</li> <li>• Utiliser avec prudence chez les malades souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale, car cela peut réduire l'élimination de la sulfadiazine absorbée</li> <li>• Chez l'adulte, jusqu'à 10% de la sulfadiazine d'argent peut être absorbé. Dont 60 à 80% est excrété dans l'urine</li> <li>• Grands brûlés : Interaction avec les hypoglycémiantes oraux et la phénytoïne (annule l'effet de ces médicaments)</li> <li>• Effets secondaires possibles : leucopénie, argyrie (dermatose, peau devient bleue-grise) ou dermatite</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfection q 24 heures pour le traitement des brûlures ou des plaies infectées</li> <li>• Réfection q 3 jours pour le traitement des plaies chroniques selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité (sulfamides)</li> <li>• Femme enceinte ou allaitante</li> <li>• Nouveau-né</li> <li>• Blessure au visage</li> <li>• Insuffisance hépatique grave</li> <li>• Éviter de combiner à un agent enzymatique</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.45

## PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE CADEXOMÈRE D'IODE


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>IODOSORB®</b> «Smith &amp; Nephew»</p> <p><i>Cadexomère d'iode 0.9% à libération lente et microsphères de polysaccharides</i></p> 	<p>10 g</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p><u>GRM</u> : voir p.63</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 58 Valide 3 mois</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuer à rétablir l'équilibre microbien dans la plaie colonisée ou infectée</li> <li>• Action antimicrobienne à large spectre</li> <li>• Diminuer la présence de tissus dévitalisés en favorisant l'autolyse</li> <li>• Absorber l'exsudat jusqu'à 6 fois son poids sec par l'effet des microsphères de polysaccharides</li> <li>• Contrôler l'odeur</li> <li>• Non cytotoxique pour les fibroblastes</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie chronique produisant un exsudat modéré à abondant</li> <li>• Plaie nécrotique humide</li> <li>• Plaie colonisée ou infectée</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Plus facile à appliquer sur le pansement que directement dans la plaie</li> <li>• Appliquer un pansement secondaire semi-perméable (ex. : <i>Telfa®</i> ou mousse)</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'onguent devient gris-beige lorsqu'il est saturé d'exsudat et que l'iode est complètement libéré dans la plaie</li> <li>• Une sensation de brûlure dans l'heure suivant l'application peut être ressentie</li> <li>• Une même série de traitement ne doit pas dépasser <b>trois mois</b></li> <li>• Ne pas utiliser plus de 50 grammes par jour ou 150 g par semaine</li> <li>• Réévaluer la pertinence du traitement toutes les 2 semaines</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection 2 à 3 fois par semaine selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité à l'iode</li> <li>• Infection</li> <li>• Femme enceinte ou allaitante</li> <li>• Enfant (&lt; 18 ans)</li> <li>• Trouble thyroïdien non stabilisé</li> <li>• Insuffisance rénale aiguë</li> <li>• Risque d'interaction avec le lithium</li> <li>• Incompatible avec les antiseptiques</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.47




**ALERTE CLINIQUE :**  
Ne pas utiliser de NaCl 0,9% car neutralise l'argent nanocristallin

## PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D'ARGENT : NANOCRISTALLIN


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>ACTICOAT FLEX 3®</b> «Smith &amp; Nephew»</p> <p><i>Composé de polyéthylène enduit d'argent nanocristallin pur à 99.999 %</i></p> 	<p>10 X 10 cm</p> <p><u>PRIX</u>: \$\$\$</p> <p><u>GRM</u>: 42046562</p> <p><u>RAMQ</u>: ∅</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire la charge microbienne de surface</li> <li>• Effet bactéricide rapide en 30 minutes</li> <li>• Effet à large spectre incluant les bactéries multirésistantes telles que SARM, ERV, Pseudomonas et champignons</li> <li>• Stimuler la cicatrisation</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie aiguë ou chronique présentant des signes de colonisation critique ou d'infection</li> <li>• Plaie peu exsudative</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec de l'eau stérile seulement</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Découper le pansement à la taille requise et le déposer directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Si la plaie est sèche, l'humidifier avec de l'eau stérile ou appliquer un hydrogel isotonique sans NaCl dans le lit de la plaie d'une mousse</li> <li>• Le recouvrir d'un pansement non-adhérent non-imprégné semi-perméable</li> <li>• Pansement d'argent peut rester en place durant 3 jours.</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessite un milieu humide</li> <li>• Possibilité d'ajouter de l'hydrogel pour faciliter l'adhésion ou pour humidifier la plaie</li> <li>• Faible toxicité pour les tissus sains</li> <li>• Le NaCl 0,9% neutralise l'argent nanocristallin</li> <li>• Peut être utilisé comme interface antimicrobienne en dessous d'une mousse noire de TPN</li> <li>• Éviter le contact avec des électrodes ou gels conducteur lors de prise de mesure électronique (Ex : ECG, EEG)</li> <li>• Peut causer une décoloration péri lésionnelle</li> <li>• Ne pas l'utiliser si la couleur n'est pas uniforme</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> <li>• Peut occasionner une sensation de brûlure</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 3 jours et PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Favoriser le retrait des tissus dévitalisés (nécrose jaune ou sèche) avant l'application afin de favoriser l'action des ions d'argent</li> <li>• Non testé chez les femmes enceintes</li> <li>• Incompatible avec les examens d'imagerie par résonance magnétique</li> <li>• Incompatible avec les produits à base d'huile ou de gelée de pétrole, ainsi que les onguents antimicrobiens ou antibiotiques</li> </ul>
	<p>40 X 40 cm</p> <p><u>PRIX</u>: \$\$\$</p> <p><u>GRM</u>: 42010259</p> <p><u>RAMQ</u>: 40 x 40cm est le seul format accepté par la RAMQ DE 58 Valide 3 mois</p> <p>Absence de latex</p>			

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.60

## PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D'ARGENT : MOUSSE HYDROCELLULAIRE


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b><u>MEPILEX AG®</u></b> <b>« Molnycke »</b></p> <p>Mousse hydrocellulaire micro-adhérente qui contient des ions d'argent</p> 	<p>10 X 10 cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046569</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 58 Valide 3 mois</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contient toutes les propriétés de la mousse hydrocellulaire en plus d'offrir une propriété antibactérienne en lien avec la libération prolongée des ions d'argent dans la plaie</li> <li>• Enduit de silicone (Technologie Safetac) en contact avec la plaie, permet retrait non traumatique</li> <li>• Rétention de l'exsudat</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie aiguë ou chronique présentant des d'infections (peut être utilisé en combinaison avec l'antibiotique systémique)</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• même que pour la mousse hydrocellulaire</li> <li>• Ne pas ajouter d'autres antimicrobiens en dessous du pansement</li> </ul> <p><b>Fréquence</b> Fréquence q 7 jours. + PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Non testé chez les femmes enceintes</li> <li>• Incompatible avec les examens d'imagerie par résonance magnétique</li> <li>• Incompatible avec les produits à base d'huile ou de gelée de pétrole, ainsi que les onguents antimicrobiens ou antibiotiques</li> </ul>

## PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D'ARGENT : ALGINATE


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>SILVERCEL® NON ADHÉRENT</b> «Acelity (Systagenix)»</p> <p><i>Composé d'alginate, de carboxyméthylcellulose et de fibres de nylon recouvert d'argent</i></p> 	<p>11x11cm</p> <p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046558</p> <p><b>RAMQ :</b> DE 58 Valide 3 mois</p> <p><b>Absence de latex</b></p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler la charge microbienne à large spectre (agis sur 150 microorganismes incluant SARM et ERV)</li> <li>• Absorber et retenir l'exsudat modéré à abondant</li> <li>• Favoriser l'hémostase</li> <li>• Non-adhérent au lit de la plaie</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie aiguë ou chronique, infectée, fortement colonisée ou à risque d'infection et ayant un exsudat modéré à abondant</li> <li>• Peut être utilisé sous une compression</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Irriguer la plaie avec eau stérile ou de l'eau saline</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Découper le pansement à la taille requise</li> <li>• L'appliquer directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Le recouvrir d'un pansement mousse hydrocellulaire ou autre selon le niveau d'exsudat</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le <i>Silvercel®</i> non adhérent : la couche de nylon perforée permet retrait facile et atraumatique</li> <li>• Nécessite un milieu humide</li> <li>• Éviter le contact avec des électrodes ou gels conducteur lors de prise de mesure électronique (Ex : ECG, EEG)</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours et PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Non testé chez les femmes enceintes</li> <li>• Plaie sèche ou peu exsudative</li> <li>• Incompatible avec des examens par imagerie par résonance magnétique</li> <li>• Incompatible avec les produits à base d'huile ou de gelée de pétrole ainsi qu'onguent antimicrobien</li> </ul>

PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE D'ARGENT : HYDROFIBRE







NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>Aquacel Ag + Extra®</b> « Convatec »</p> <p><i>2 couches de Carboxyméthylcellulose imprégnée de 1.2% d'ions d'argent. Contient EDTA et chlorure de benzéthonium(surfactant)</i></p> 	<p>Comprese: 10 X 10 cm <u>PRIX</u> : \$\$\$ <u>GRM</u> : 42046553</p> <p>Mèche : 2cm X 45 cm <u>PRIX</u> : \$\$\$ <u>GRM</u> : 42046554</p> <p><u>RAMQ</u> : DE 58 Valide 3 mois</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler la charge microbienne à large spectre (agis sur 150 microorganismes incluant SARM et ERV)</li> <li>• La technologie « hydrofiber» a propriété absorbante qui se transforme en gel lorsqu'elle entre en contact avec le liquide d'une plaie.</li> <li>• Absorber et retenir les l'exsudat modéré à abondant</li> <li>• AG+ indique la présence d'un surfactant agissant contre le biofilm</li> </ul> <p><b>Indications :</b> Plaie aiguë ou chronique, infectée, fortement colonisée ou à risque d'infection et ayant un exsudat modéré à abondant</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Irriguer la plaie avec eau stérile ou eau saline</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Découper le pansement à la taille requise. L'appliquer directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Le recouvrir d'un pansement mousse hydrocellulaire</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessite un milieu humide</li> <li>• Éviter le contact avec des électrodes ou gels conducteur lors de prise de mesure électronique (Ex : ECG, EEG)</li> <li>• Réévaluer le traitement toutes les 2 semaines</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours +PRN selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Non testé chez les femmes enceintes</li> <li>• Plaie sèche ou peu exsudative</li> <li>• Incompatible avec des examens par imagerie par résonance magnétique</li> <li>• Incompatible avec les produits à base d'huile ou de gelée de pétrole ainsi qu'onguent antimicrobien ou antibiotique</li> <li>• Déconseillé dans un sinus ou un tunnel étroit dont on ne voit pas le fond, car il peut laisser des débris</li> </ul>

PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE VIOLET DE GENTIANE ET BLEU DE MÉTHYLÈNE

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>HYDROFERA BLUE®</b> <b>CLASSIC</b> «Hollister»</p> <p><i>Pansement en mousse hydrophile à cellules ouvertes est à base d'alcool polyvinylique (APV). Celui-ci est lié à deux pigments, le bleu de méthylène et le violet de gentiane</i></p> 	<p>10 X 10 cm</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046563</p> <p><u>RAMQ</u> : Ø</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection antibactérienne à large spectre</li> <li>• Mousse absorbante et rétenteur de l'humidité</li> <li>• Favorise le débridement autolytique</li> <li>• Non cytotoxique</li> <li>• Compatible avec l'agent de débridement enzymatique (Santyl)</li> </ul> <p><b>Indications:</b> Plaie aiguë ou chronique, infectée, fortement colonisée ou à risque d'infection et ayant un exsudat léger à abondant</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec le NaCl 0,9% ou eau stérile, et éponger son pourtour</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané</li> <li>• Couper le pansement selon les dimensions de la plaie</li> <li>• <i>Hydrofera Blue®Classic</i>: humidifier complètement le pansement avec du NaCl 0,9% ou de l'eau stérile</li> <li>• Essorer le pansement avant l'application</li> <li>• Appliquer un pansement secondaire pour recouvrir <i>Hydrofera Blue®</i> selon l'exsudat (ex : compresses et <i>Kling®</i>, mousse hydrocellulaire)</li> <li>• Si peu d'exsudat, recouvrir le pansement <i>Hydrofera Blue®</i> d'une pellicule transparente</li> <li>• <i>Hydrofera Blue®Ready</i>: non nécessaire de l'humidifier. Couvrir d'un recouvrement adhésif (ex : <i>Mefix®</i>) ou pellicule transparente</li> <li>• Peut être utilisé sous la compression ou sous un plâtre de contact total</li> </ul> <p><b>Fréquence :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hydrofera Blue®Classic</i>: Un premier changement devrait être fait après 24-48 heures pour évaluer la fréquence de réfection du pansement</li> <li>• Ensuite : changement q 72 heures ou si pansement décoloré (la coloration blanche indique la perte d'efficacité de l'antimicrobien), selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Brûlure 3<sup>ème</sup> degré</li> </ul>


Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.52

## PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE PHMB (Polyhexaméthylène Biguanide) et +


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>MOUSSE de transfert sans bordure</b> <b>KENDALL AMD®</b> «Covidien» Composé d'une mousse de polyuréthane imprégnée de PHMB 0,5%</p> 	<p><b>PRIX :</b> \$\$\$ (10x10cm) \$\$\$ (10x20cm)</p> <p><b>GRM :</b> 10x10cm : 42046556 10x20cm : 42046555</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p>	<p><b>Action :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire la charge microbienne de surface</li> <li>• Détruire les bactéries à large spectre telles que Gram positif et négatif incluant SARM, ERV, Pseudomonas, A. baumannii, champignons et levures</li> </ul> <p><u>Mousse de transfert sans bordure</u>: transfert de l'exsudat à un pansement secondaire pour prolonger la durée du port du pansement. Peut être utilisé sous compression</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec le NaCl 0,9%</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Le déposer directement sur la plaie</li> </ul> <p><u>Mousse de transfert :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessite un pansement secondaire</li> </ul> <p><u>Mèche :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter un hydrogel PRN pour faciliter l'insertion</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non testé pour une clientèle pédiatrique</li> <li>• Absence de latex</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Mousse</u> : q 7 jours +PRN</li> <li>• <u>Gaze en rouleau et compresses</u> : q 3 jours ou changer dès que humide</li> <li>• <u>Mèche</u> : q 3 jours</li> <li>• Selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> </ul>
<p><b>GAZE EN ROULEAU KERLIX AMD®</b> «Covidien» Composé de gazes imprégnées de PHMB 0,2%</p> 	<p><b>PRIX :</b> \$\$ (11,4 x 3,7m)</p> <p><b>GRM :</b> 11,4 x 3,7m : 42046557</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p>	<p><u>Gaze en rouleau</u> : insérer dans plaie profonde, irrégulière et utilisé lors TPN</p> <p>Traiter une infection fongique des plis cutanés</p> <p><u>Mèche</u> : emballage individuel, idéal sinus</p>		
<p><b>MÈCHE CURITY AMD®</b> «Covidien» Mèche de coton imprégné de PHMB 0.2%</p> 	<p><b>PRIX :</b> \$\$</p> <p><b>GRM :</b> 1" (2,5cm) : 42046546 1/2"(1,3cm) : 42046561 1/4"(0,6cm) : 42046560</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p>	<p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaies aiguës ou chroniques infectées, fortement colonisées ou à risque d'infection</li> <li>• Pour application comme pansement primaire</li> <li>• Pour les plaies profondes et chroniques, les plaies de grandes dimensions, les plaies chirurgicales</li> <li>• <u>Le Rouleau et les compresses</u> peuvent être utilisés pour traiter intertrigo dans les plis cutanés. Peut ne pas être stérile et garder dans un contenant propre. Se référer au Protocole du soin de la peau du CISSS des Laurentides</li> </ul>		
<p><b>COMPRESSES 4 ÉPAISSEURS®</b> «Covidien» Comresse de coton 0.2% PHMB</p> 	<p><b>PRIX :</b> \$ (10cm x 10cm)</p> <p><b>GRM :</b> 42046559</p> <p><b>RAMQ :</b> Ø</p>			

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.51

## NITRATE D'ARGENT (AgNO<sub>3</sub>)


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b><u>NITRATE D'ARGENT</u></b> <b><u>(AgNO<sub>3</sub>)</u></b></p> <p><i>Composé de 75 % de nitrate d'argent et de 25 % de nitrate de potassium</i></p> 	<p>Bâtonnet</p> <p><u>PRIX</u> : \$</p> <p><u>GRM</u> : voir p.63</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cautériser les tissus d'hypergranulation</li> <li>• Contrôler un saignement</li> <li>• Stimuler une plaie atone</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaie chronique présentant de l'hypergranulation</li> <li>• Saignement mineur lors du débridement chirurgical conservateur avec instrument</li> <li>• Plaie atone nécessitant une stimulation afin de poursuivre le processus de cicatrisation</li> <li>• Hypergranulation péristomial. Ne doit pas être appliqué sur la muqueuse intestinale</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec de l'eau stérile</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Appliquer le nitrate d'argent en le roulant sur les tissus</li> <li>• Si plaie sèche, mouiller préalablement l'extrémité avec de l'eau stérile avant d'utiliser le produit</li> <li>• Les applicateurs peuvent être recourbés ou pliés afin d'atteindre plus facilement la région cible</li> <li>• Au besoin, neutraliser avec NaCl 0,9% pour arrêter le processus de cautérisations (ex : si douleur)</li> <li>• Utiliser un maximum de deux bâtonnets consécutifs</li> <li>• Ne pas appliquer sur la peau saine</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Après l'application, les tissus cautérisés deviennent rapidement grisâtres et une sensation de brûlure peut être ressentie</li> <li>• Le NaCl 0,9% désactive le produit</li> <li>• Conserver les bâtonnets à l'abri de la lumière dans le contenant original</li> <li>• Mettre des gants pour utiliser le produit, car peut tâcher les mains</li> <li>• Approuvé pour usage pédiatrique</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> PRN : 3x/semaine maximum, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Plaie localisée au visage ou au cou</li> <li>• Brûlure ou plaie chirurgicale suite à une plastie</li> <li>• Lésion sur une muqueuse</li> </ul>

## AGENT DE DÉBRIDEMENT ENZYMATIQUE

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE- INDICATIONS
<p><b>SANTYL®</b> <b>COLLAGENASE</b> «Smith&amp;Nephew»</p> <p><i>Composé de collagénase (Clostridium histolyticum fermenté) dans la gelée de pétrole blanche (250u/g)</i></p> 	<p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> Pharmacie</p> <p><b>RAMQ :</b> DE 158 Valide 60 jours</p> <p><b>Absence de latex</b></p>	<p><b>Actions:</b> Liquéfier les protéines de la nécrose. Cible seulement les tissus dévitalisés</p> <p><b>Indications :</b> Plaie nécrotique qui présente un potentiel de cicatrisation</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec le NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Scarifier l'escarre au besoin (voir section «Débridement de plaies» du «Programme de soins de plaies» au portail clinique) ou la MSI « Débridement d'une plaie »</li> <li>• Appliquer une couche de <b>2 à 3 mm</b> sur la nécrose</li> <li>• S'il y a une cavité, appliquer le produit sur une compresse humide ou une mèche. Sinon, badigeonner la cavité et combler avec une compresse humide</li> <li>• Si la plaie est sèche, ajouter une compresse humidifiée avec le NaCl 0,9%</li> <li>• Appliquer un pansement rétenteur d'humidité non-adhérent non-imprégné couvert d'une pellicule transparente afin de maintenir l'humidité</li> <li>• Au fur et à mesure que les tissus se détachent ou ramollissent, faire un débridement chirurgical conservateur.</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agent de débridement enzymatique sélectif</li> <li>• Servie par la pharmacie, car le produit est considéré comme un médicament</li> <li>• Ne pas appliquer sur la peau saine ou au pourtour de la plaie, car il peut causer de l'irritation</li> <li>• Ne pas le combiner avec des métaux lourds (ex. : argent), de l'iode, des détergents, etc.)</li> <li>• Réévaluer la pertinence du traitement toutes les 2 semaines</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection DIE jusqu'au débridement complet ou à l'apparition suffisante de la granulation selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Infection</li> <li>• Plaie sans potentiel de cicatrisation</li> <li>• Ulcère du pied diabétique ad évaluation médicale</li> <li>• L'utilisation sécuritaire sur des structures, telles que tendons et os, n'a pas été prouvée</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.49

## BIOMATÉRIAUX : PROMOGRAN PRISMA

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>PROMOGRAN PRISMA®</b> <b>«ACELITY»</b></p> <p><i>Composé d'un composé lyophilisé, stérile, de cellulose oxydée régénérée et de collagène combiné à de l'argent</i></p> 	<p>28cm<sup>2</sup></p> <p><u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046568</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduler et rééquilibrer l'environnement de la plaie par une synergie unique : d'une part, liaison et inactivation des protéases et d'autre part, liaison et protection des facteurs de croissance naturellement présentes dans la plaie</li> <li>• Produire un effet antimicrobien, antioxydant</li> <li>• Stimuler la prolifération cellulaire</li> <li>• Réduire les cytokines inflammatoires</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lésion de pression</li> <li>• Ulcère veineux</li> <li>• Ulcère diabétique</li> <li>• Ulcère mixte</li> <li>• Plaie traumatique et post-traumatique</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec le NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Découper la feuille légèrement plus grande que la plaie</li> <li>• L'appliquer directement sur le lit de la plaie</li> <li>• Peut-être humidifié avec du NaCl 0,9% lors de l'application, si plaie peu exsudative</li> <li>• Le recouvrir d'un pansement secondaire non adhérent ou absorbant</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doit être appliqué sur une plaie préalablement débridée</li> <li>• Peut être utilisé sous traitement compressif</li> <li>• Forme un gel biodégradable au contact de l'exsudat ou du NaCl 0,9%</li> <li>• Lors du changement de pansement : retirer les morceaux de pansement qui n'ont pas formé de gel et jetez-les</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 24 à 72 h selon l'exsudat et évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Brulure 3<sup>ème</sup> degré</li> </ul>


Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.53



**ALERTE CLINIQUE :**

**Contre indiqué si Indice tibio-brachial <0,8 mmHg**

## BANDAGE COMPRESSIF ÉLASTIQUE MULTICOUCHES - SUREPRESS

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>SUREPRESS®</b> «Convatec»</p> <p>Bandage élastique <i>Composé de bandage élastique fait de coton, viscose, nylon et lycra avec des lignes médianes de couleur jaune et deux indicateurs d'extension rectangulaire à appliquer par-dessus un bandage ouaté</i></p> 	<p>Bandage élastique 10cm x 3m</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$\$</p> <p><u>GRM</u> : 42046541 (bandage)</p> <p>Ouate orthopédique 10cm x 3,65m</p> <p><u>GRM</u> : voir p.63</p> <p><u>PRIX</u> : \$\$</p> <p><u>GRM</u> :</p> <p><u>RAMQ</u> : ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b> Assurer une forte compression de 35-45 mmHg soutenue et graduée</p> <p><b>Indications :</b> Ulcère veineux de la jambe</p> <p>Doit être appliqué par une infirmière ayant eu la formation et/ou une supervision par une infirmière ressource</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuer les soins de plaie selon le plan de traitement déterminé par l'infirmière en utilisant un pansement mince et compressible sur la plaie pour éviter le risque de point de pression</li> <li>ITB nécessaire au préalable à l'installation initiale</li> <li>Mesurer la cheville <ul style="list-style-type: none"> <li>Si 18 à 26 cm : taille normale → suivre les petits rectangles</li> <li>Si &gt; 26 cm : Taille forte → suivre les grands rectangles</li> </ul> </li> <li>Ajouter de la ouate sur les saillies osseuses PRN, et si la cheville est &lt;18cm</li> <li>Appliquer le bandage ouaté en premier et ensuite le bandage élastique, de la base des orteils jusqu'à deux doigts en dessous du genou en faisant d'abord deux tour d'encrage, puis le tour de la cheville en 8 ou en circulaire, couvrir ensuite la plante du pied et monter le bandage circulaire sur toutes la jambe en chevauchant de 50 %</li> <li>Couper les bandages superflus et fixer l'extrémité avec du ruban adhésif</li> <li>Appliquer une bande de ruban adhésif ou <i>Mefix®</i> sur toute la longueur de la jambe pour éviter le glissement du bandage lors de la marche</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indice tibio-brachial ≥0,8 mmHg</li> <li>Laver à la main à l'eau chaude savonneuse 40 degré Celsius (maximum 20 fois) et rincer à l'eau tiède</li> <li>Sécher à plat</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours ou PRN et selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie ou sensibilité</li> <li>Ulcère artériel</li> <li>Ulcère mixte</li> <li>Indice tibio-brachial &lt;0,8 mmHg</li> <li>Tour de cheville &lt;18cm</li> <li>Non tolérée par l'utilisateur ou non-observance</li> </ul>



Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.55



**ALERTE CLINIQUE :**

Contre indiqué si Indice tibio-brachial < 0,8 mmHg (COBAN 2)  
ou indice tibio-brachial < 0.5 (COBAN 2 LITE)

**BANDAGE COMPRESSIF À COURTE ÉLASTICITÉ – COBAN 2 et COBAN 2 LITE**


NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE- INDICATIONS
<p><b>COBAN 2<sup>®</sup></b> « 3M »</p>  <p><i>Système de bandage compressif à courte élasticité Couche confort intérieure est constituée d'une mousse de polyuréthane stratifiée et d'un bandage cohésif. Couche extérieure consiste en un bandage cohésif. Le Coban est à usage unique : disponible après chaque utilisation</i></p> <p><b>COBAN 2 Lite<sup>®</sup></b> « 3M »</p> 	<p><b>Coban 2<sup>®</sup></b></p> <p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046540</p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Absence de latex</p> <hr/> <p><b>Coban 2 Lite<sup>®</sup></b></p> <p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> 42046539</p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <p><b>COBAN 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer une forte compression soutenue ad 7 jours</li> <li>ITB &gt; 0.8</li> <li>Compression moyenne de 40mmHg</li> </ul> <p><b>COBAN 2 LITE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer une compression plus faible</li> <li>ITB entre 0.50 et 0.79</li> <li>Compression moyenne de 25 mmHg</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ulcère veineux (Coban 2<sup>®</sup>)</li> <li>Ulcère mixte (Coban 2 Lite<sup>®</sup>)</li> <li>Lymphoedème</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuer les soins de plaie selon le plan de traitement déterminé par l'infirmière en utilisant un pansement mince et compressible sur la plaie pour éviter le risque de point de pression</li> <li>ITB nécessaire au préalable à l'installation initiale</li> </ul> <p><b>Couche #1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer un pansement mince et absorbant sur la plaie</li> <li>Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche (côté mousse contre la peau) en commençant à l'enrouler à la base des orteils. Le pied doit se trouver en dorsiflexion.</li> <li>Le 2<sup>e</sup> tour doit passer sur le dessus du pied; faire passer le milieu de la bande par-dessus la malléole interne</li> <li>Une partie du talon et face plantaire sera découverte : ce n'est pas grave.</li> <li>Remonter en spirale jusqu'à 2 doigts en dessous du genou avec le moins de chevauchement possible (pour éviter le surplus d'épaisseur) et en tendant juste assez pour que le bandage épouse la forme de la jambe.</li> <li>Couper le surplus de bandage</li> </ul> <p><b>Couche #2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer le bandage en commençant à l'enrouler à la base des orteils par-dessus la couche # 1. Commencer déjà à l'étirer à son maximum</li> <li>Effectuer 1 à 3 formes de huit autour de la cheville afin de bien couvrir le talon d'au moins 2 couches</li> <li>Continuer à l'enrouler jusqu'au genou avec chevauchement de 50% et l'étirement doit être uniforme pendant toute l'application</li> <li>Appliquer une légère pression sur toute la jambe afin de bien mouler le bandage. Couper le surplus et jeter</li> <li>Au retrait du bandage, l'enlever avec des ciseaux</li> </ul> <p><b>Fréquence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peut rester ad 7 jours ou PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie ou sensibilité</li> <li>Ulcère artériel</li> <li>Ulcère mixte (Coban 2<sup>®</sup>)</li> <li>ITB &lt; 0.5</li> <li>Non toléré par l'utilisateur</li> <li>Non observance</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.57




**ALERTE CLINIQUE : Ne pas confondre avec TUBIGRIP dont la charte de compression diffère. Contre indiqué si Indice tibio-brachial <0,6 mmHg**

## BANDAGE COMPRESSIF TUBULAIRE 1 COUCHE : ELASTIGRIP

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS																																																											
<p><b>ELASTIGRIP®</b> <b>«AMG MEDPRO»</b></p> 	<p><b>PRIX / Boîte :</b> Taille C : \$\$\$ Taille D : \$\$\$ Taille E : \$\$\$ Taille F : \$\$\$ Taille G : \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> voir p.63</p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Absence de latex</p>	<p><b>Actions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer une compression tubulaire faible à modérer (non dégressive)</li> </ul> <p><b>Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ulcère veineux et mixte</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indice tibio-brachial <math>\geq 0,6</math> mmHg nécessaire</li> <li>Lavable pour un maximum de 20 fois</li> <li>Ne pas le confondre avec Tubigrip® dont la charte de compression diffère</li> </ul>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuer les soins de plaie selon le plan de traitement déterminé par l'infirmière en utilisant un pansement mince et compressible sur la plaie pour éviter le risque de point de pression</li> <li>ITB nécessaire au préalable à l'installation initiale</li> <li>Mesurer la circonférence maximale du mollet et choisir la taille en fonction de cette mesure et du degré de compression</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">TENSION (mmHg)</th> </tr> <tr> <th>BAS (5-10 mmHg)</th> <th>MOYEN (10-20 mmHg)</th> <th>HAU? (20-30 mmHg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">Circonférence des parties du corps (cm)</td> </tr> <tr> <td><b>A</b></td> <td>5.0 - 6.0</td> <td>6.5 - 7.5</td> <td>8.0 - 11.5</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td>6.5 - 7.5</td> <td>8.0 - 11.5</td> <td>12.0 - 20.5</td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td>8.0 - 11.5</td> <td>12.0 - 20.5</td> <td>21.0 - 31.5</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td>12.0 - 20.5</td> <td>21.0 - 31.5</td> <td>32.0 - 41.0</td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td>21.0 - 31.5</td> <td>32.0 - 41.0</td> <td>41.5 - 49.5</td> </tr> <tr> <td><b>F</b></td> <td>32.0 - 41.0</td> <td>41.5 - 49.5</td> <td>47.0 - 56.5</td> </tr> <tr> <td><b>G</b></td> <td>41.5 - 49.5</td> <td>50.0 - 57.5</td> <td>58.0 - 66.5</td> </tr> <tr> <td><b>H</b></td> <td>50.0 - 57.5</td> <td>58.0 - 66.5</td> <td>67.0 - 82.5</td> </tr> <tr> <td><b>J</b></td> <td>58.0 - 66.5</td> <td>67.0 - 82.5</td> <td>83.0 - 90.0</td> </tr> <tr> <td><b>K</b></td> <td>67.0 - 82.5</td> <td>83.0 - 90.0</td> <td>90.5 - 102.0</td> </tr> <tr> <td><b>L</b></td> <td>83.0 - 90.0</td> <td>90.5 - 102.0</td> <td>102.5 - 112.0</td> </tr> <tr> <td><b>M</b></td> <td>90.5 - 102.0</td> <td>102.5 - 112.0</td> <td>112.5 - 120.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Enfiler le bandage compressif tubulaire de la base des orteils jusqu'à deux doigts en dessous du genou (1 épaisseur)</p> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection selon l'évaluation de l'infirmière</p>		TENSION (mmHg)			BAS (5-10 mmHg)	MOYEN (10-20 mmHg)	HAU? (20-30 mmHg)		Circonférence des parties du corps (cm)			<b>A</b>	5.0 - 6.0	6.5 - 7.5	8.0 - 11.5	<b>B</b>	6.5 - 7.5	8.0 - 11.5	12.0 - 20.5	<b>C</b>	8.0 - 11.5	12.0 - 20.5	21.0 - 31.5	<b>D</b>	12.0 - 20.5	21.0 - 31.5	32.0 - 41.0	<b>E</b>	21.0 - 31.5	32.0 - 41.0	41.5 - 49.5	<b>F</b>	32.0 - 41.0	41.5 - 49.5	47.0 - 56.5	<b>G</b>	41.5 - 49.5	50.0 - 57.5	58.0 - 66.5	<b>H</b>	50.0 - 57.5	58.0 - 66.5	67.0 - 82.5	<b>J</b>	58.0 - 66.5	67.0 - 82.5	83.0 - 90.0	<b>K</b>	67.0 - 82.5	83.0 - 90.0	90.5 - 102.0	<b>L</b>	83.0 - 90.0	90.5 - 102.0	102.5 - 112.0	<b>M</b>	90.5 - 102.0	102.5 - 112.0	112.5 - 120.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergie ou sensibilité</li> <li>Indice tibio-brachial &lt;0,6 mmHg</li> <li>Personne diabétique avec micro angiopathie avancée</li> </ul>
	TENSION (mmHg)																																																														
	BAS (5-10 mmHg)	MOYEN (10-20 mmHg)	HAU? (20-30 mmHg)																																																												
	Circonférence des parties du corps (cm)																																																														
<b>A</b>	5.0 - 6.0	6.5 - 7.5	8.0 - 11.5																																																												
<b>B</b>	6.5 - 7.5	8.0 - 11.5	12.0 - 20.5																																																												
<b>C</b>	8.0 - 11.5	12.0 - 20.5	21.0 - 31.5																																																												
<b>D</b>	12.0 - 20.5	21.0 - 31.5	32.0 - 41.0																																																												
<b>E</b>	21.0 - 31.5	32.0 - 41.0	41.5 - 49.5																																																												
<b>F</b>	32.0 - 41.0	41.5 - 49.5	47.0 - 56.5																																																												
<b>G</b>	41.5 - 49.5	50.0 - 57.5	58.0 - 66.5																																																												
<b>H</b>	50.0 - 57.5	58.0 - 66.5	67.0 - 82.5																																																												
<b>J</b>	58.0 - 66.5	67.0 - 82.5	83.0 - 90.0																																																												
<b>K</b>	67.0 - 82.5	83.0 - 90.0	90.5 - 102.0																																																												
<b>L</b>	83.0 - 90.0	90.5 - 102.0	102.5 - 112.0																																																												
<b>M</b>	90.5 - 102.0	102.5 - 112.0	112.5 - 120.0																																																												

## PANSEMENT POST-OPÉRATOIRE

NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ACTIONS ET INDICATIONS	INSTRUCTIONS ET PARTICULARITÉS	CONTRE-INDICATIONS
<p><b>MEPILEX Border Post-Op</b> <i>Mölnlycke</i></p>  <p><b>Mepilex® Border Post-Op</b> <small>AVEC TECHNOLOGIE SAFETY™</small></p>	<p><b>PRIX :</b> \$\$\$</p> <p><b>GRM :</b> 9 x 30cm <b>42046576</b> 10 x 20cm <b>42046577</b> 10 x 25cm <b>42046578</b></p> <p><b>RAMQ :</b> ∅</p> <p>Sans latex</p>	<p><b>Actions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pansement absorbant conçu pour les plaies à exsudat abondant optimisé pour l'usage post opératoire et l'absorption de sang</li> <li>• Réduit la formation de phlyctène</li> <li>• Flexible, idéal pour les plaies chirurgicales orthopédiques</li> </ul> <p><b>Indications :</b> Plaie post-opératoire avec un exsudat léger à abondant</p>	<p><b>Instructions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la plaie avec NaCl 0,9%</li> <li>• Assécher le pourtour en l'épongeant</li> <li>• Appliquer un protecteur cutané au besoin</li> <li>• Choisir un format de 2 à 3 cm plus grand que la plaie.</li> <li>• La partie collante doit être en contact (silicone) avec la plaie</li> </ul> <p><b>Particularités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser avec des agents oxydant (<i>Dakin®</i>) ou eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène)</li> <li>• Semi-perméable, imperméable à l'eau</li> <li>• Bordures de silicone. Permet de décoller pour visualiser et de recoller par la suite</li> <li>• Ne peut être découpé au centre, seulement la bordure de silicone pour permettre la superposition</li> </ul> <p><b>Fréquence d'utilisation :</b> Réfection q 7 jours ou avant PRN, selon l'évaluation de l'infirmière</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie ou sensibilité</li> <li>• Plaie infectée non traitée</li> </ul>

Informations complémentaires disponibles : voir notice de la compagnie p.62

## **ANNEXE : Notices des compagnies**

# Critic-Aid Clear®

## Barrière protectrice claire

- Pour soulager l'irritation de la peau de légère à sévère causée par l'incontinence
- Adhère à la peau saine, dénudée ou humide
- Permet de prévenir les dommages causés par l'urine, les fèces ou la diarrhée
- Sa formulation claire permet une évaluation facile de l'état de la peau
- Aide au processus de cicatrisation

## MODE D'EMPLOI

En cas d'irritation ou de risque d'excoriation, utilisez la barrière Critic Aid Clear®

- Appliquer lors de chaque changement, suite à un épisode d'incontinence

### Application :

- Nettoyer délicatement la peau périnéale avec un nettoyant doux, bien assécher la peau en tapotant spécifiquement dans les replis cutanés.
- Étendre une mince couche sur la peau, ne pas frotter ou tenter de faire pénétrer dans la peau.



*Ne pas appliquer le produit en trop grande quantité*

- Reste bien en place tout en étant facile à appliquer et à enlever.





Triad™



## Triad™

### Pansement hydrophile

#### Caractéristiques et avantages

- S'applique facilement dans les endroits difficiles à panser
- Favorise le débridement autolytique
- Long temps de port – Jusqu'à 7 jours
- Sécuritaire pour la zone périlésionnelle – ne cause pas de macération autour de la plaie
- Adhère à la peau humide, suintante ou érodée

#### Description

- Pansement hydrophile qui adhère bien à la peau humide et suintante, offrant une solution efficace pour panser les plaies situées dans des endroits qui ne se prêtent pas aux pansements traditionnels
- Favorise le débridement autolytique en ramollissant et en dégageant les tissus nécrotiques afin de promouvoir le processus de guérison
- Absorbe l'exsudat de plaies faiblement ou moyennement exsudatives tout en conservant un milieu humide propice à une cicatrisation normale.

#### Utilisation

- Triad est recommandé pour la prise en charge locale des ulcères de pression et veineux, de lésions et de blessures dermiques exsudatives, des égratignures et des plaies superficielles, des brûlures au premier et au deuxième degré, et des plaies d'épaisseur partielle ou de pleine épaisseur.
- Convient pour une utilisation chez les nouveau-nés



#### Triad

Taille	Code de produit	Unités par boîte
Tube de 71 g	1964	12
Tube de 170 g	1967	12



## Mode d'emploi

### Débridement autolytique

1. Appliquez une couche de Triad sur le tissu nécrotique et sur la région en périphérie de la plaie.
2. Appliquez l'épaisseur d'une pièce de dix cents.
3. Pour aider l'absorption du tissu nécrotique liquéfié, recouvrez Triad d'un pansement secondaire absorbant, comme le pansement de mousse Blatain®, au besoin.
4. La quantité d'exsudat dicte la fréquence des changements de pansements. Changez Triad au moins tous les 5 à 7 jours.

### Information importante

Après que la plaie a été débridée, Triad peut encore être utilisé pour promouvoir un milieu de cicatrisation humide.



Jour 1



Jour 2



Jour 3

### Plaies peu profondes

1. Appliquez une couche de Triad directement sur la plaie
2. Appliquez l'épaisseur d'une pièce de dix cents.
3. Recouvrez Triad d'un pansement secondaire tel qu'un pansement de mousse Blatain ou un pansement hydrocolloïde Comfeel® Plus, au besoin.
4. La quantité d'exsudat dicte la fréquence des changements de pansement. Changez Triad au moins tous les 5 à 7 jours.



Triad appliqué directement sur la plaie



Gaze imprégnée avec Triad

### Plaies profondes

(y compris celles avec cavité ou tunnellation)

1. Imprégnez une gaze de 10 x 10 cm ou une mèche de gaze à l'aide de Triad.
2. Entassez librement la gaze dans la plaie et dans les zones avec cavité. Placez la gaze imprégnée de sorte qu'elle puisse être facilement retirée de la plaie.
3. Recouvrez Triad d'un pansement secondaire absorbant, comme le pansement de mousse Blatain®.
4. Les pansements de gaze imprégnés sont généralement remplacés toutes les 24 heures ou selon les protocoles de soins de plaies existants.

### Retrait de Triad

1. Retirez délicatement le pansement secondaire. Retirez tout pansement de gaze imprégné.
2. Pulvérisez la plaie et la région péri-lésionnelle avec le nettoyant pour plaies Sea-Cleans®.
3. Essuyez délicatement Triad avec un morceau de gaze propre. Répétez ce processus au besoin.

### Conseil importante

Contrairement aux hydrogels ou aux autres pâtes pour les plaies, Triad ne causera pas de dermatite associée à l'humidité autour de la plaie (macération péri-lésionnelle).

Soins des stomies  
Soins d'urologie et d'incontinence  
Soins des plaies et de la peau

Coloplast développe des produits et services qui simplifient la vie de personnes aux prises avec des problèmes médicaux intimes et esthétiques. Travaillant en étroite collaboration avec les gens qui utilisent nos produits, nous créons des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques. C'est ce que nous apportons les soins de santé intimes. Nos affaires incluent les soins de stomies, l'urologie et les soins de continence ainsi que les soins de la peau et des plaies. Nous aurons dans le monde entier et employons plus de 7000 personnes.

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © 2014-05.  
Tous droits réservés, Coloplast, Mississauga, Canada.




Coloplast Canada  
3300 Ridgeway Drive Unit 12  
Mississauga, ON L5L 5Z9  
1-877-820-7008  
[www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca)

F1294N



## PANSEMENT ABSORBANT IMPRÉGNÉ DE CHLORURE DE SODIUM

- L'action détersive physiologique favorise la cicatrisation des plaies, même infectées.
- Absorbe l'exsudat, les bactéries et les débris de nécrose.
- Application facile, une seule opération
- Crée un milieu hypertonique hostile aux microorganismes.
- Maintient l'équilibre bactérien.
- Conserve son intégrité, même saturé.



### Mode d'action de Mesalt

Mesalt s'applique sec. Au contact de l'épanchement, les cristaux de chlorure de sodium se dissolvent pour créer un milieu hypertonique qui absorbe les liquides, résorbe l'œdème et entraîne les débris dans le pansement. Pendant ce processus de déterision physiologique, le milieu humide de la plaie est maintenu.


### Indications

Mesalt est destiné aux plaies moyennement ou fortement exsudatives; plaies avec escarre jaune ou fibrineuse; plaies infectées.


### Contre-indications

Plaies sèches ou faiblement exsudatives.


### Application de Mesalt



Nettoyer délicatement la plaie et son pourtour. NE PAS ÉPONGER L'EXCÈS D'HUMIDITÉ.



Ouvrir le pansement et le déposer dans la plaie sans déborder. Bourrer lâchement les plaies profondes.



Couvrir d'un pansement Alldress ou Ete avec Mefix. Changer Mesalt à toutes les 24 heures ou plus souvent si la plaie coule beaucoup ou que le protocole le prescrit.

### N.B.

Au début du traitement avec Mesalt, il se peut que l'écoulement soit plus copieux et la plaie plus profonde, car Mesalt réduit l'œdème et enlève les débris de la plaie.

### Avantages de Mesalt

- Stimule la déterision physiologique de la plaie
- Maintient l'équilibre bactérien
- Facile d'emploi

## Mesalt



### Sélection Mesalt

N° réf.	Taille cm	Qté/boîte	Qté/caisse
Mesalt®			
285580	5 x 5	30	240
285780	7,5 x 7,5	30	240
286080	10 x 10	30	180
Mesalt® Ribbon			
285280	2 x 100	10	80

Mölnlycke Health Care  
1-800-494-5134

Mölnlycke Health Care, son symbole social, Mesalt® et Mesalt® Ribbon sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care A.B.

MÖLNLYCKE  
HEALTH CARE

CA 132450801FR

# Mepilex® Border

## MOUSSE SILICONÉE SAFETAC, AUTO-ADHÉRENTE ET ABSORBANTE

- Son absorptivité supérieure favorise l'équilibre hydrique optimal et réduit le risque de macération
- Trauma et douleur minimales quand on renouvelle le pansement
- La pellicule résiste aux virus, aux bactéries et à l'eau pour protéger patients et cliniciens

### Pellicule externe à perméabilité dynamique

- Absorptivité supérieure
- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Mince et souple; faible coefficient de frottement, fixation solide

### Mousse améliorée, régulatrice d'humidité

- Construction stratifiée perfectionnée
- Absorption optimale des liquides
- Conserve son intégrité
- Épouse les formes
- Favorise l'équilibre hydrique optimal



### Couche de silicone molle Safetac®


- Fixation solide
- Le pansement s'enlève sans endommager la plaie ou la peau péri-lésionnelle
- Réduit le risque de macération

**Safetac**  
TECHNOLOGIE

### Technologie Safetac

#### Technologie Safetac. Moins de trauma. Moins de douleur.

Safetac est une technologie brevetée d'enduction de la silicone. Les pansements issus de la technologie Safetac sont atraumatiques pendant le port et le retrait. Ils minimisent les traumas sur la plaie et la peau, ce qui réduit la douleur. Ils préviennent aussi la macération en formant un sceau sur la plaie, ce qui protège la zone péri-lésionnelle.



Arrachement de l'épiderme sous un adhésif traditionnel




Pas d'épiderme arraché sous Safetac

### Mode d'action de Mepilex Border

Mepilex Border est une mousse auto-adhérente à l'absorptivité supérieure, à perméabilité dynamique, dotée de tous les avantages de la silicone molle SafetaC. Elle adhère délicatement à la peau péri-lésionnelle sans coller aux plaies humides. Cela réduit au minimum la douleur et les traumatismes aux plaies et à leur pourtour. Ce pansement imperméable résiste aux virus et aux bactéries. Son coussinet stratifié favorise un équilibre hydrique optimal et une excellente absorption.

### Application de Mepilex Border




1. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher le pourtour. Choisir un pansement assez grand pour déborder la plaie d'au moins 2 cm. Retirer la pellicule anti-adhérente.

### Indications

Mepilex Border est un pansement polyvalent qui convient à diverses plaies :

- Ulcères de jambe
- Plaies douloureuses
- Plaies de pression
- Plaies au pourtour fragilisé
- Plaies chirurgicales
- Mepilex Border s'utilise comme pansement primaire des plaies superficielles ou comme pansement secondaire des plaies profondes. Idéal pour les plaies modérément ou copieusement exsudatives.



2. Poser la mousse sur la plaie. Lisser la bordure adhésive. Ne pas étirer. Mepilex Border peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon le niveau d'exsudat et l'état de la plaie.

### Avantages de Mepilex Border

- Aucune fixation requise
- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Ne colle pas aux plaies humides
- Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon l'état de la plaie et la quantité d'exsudat
- Entretien un milieu humide sur la plaie
- Épouse les formes du corps

## Mepilex Border



Mölnlycke Health Care  
1-800-494-5134

Mölnlycke Health Care, son symbole social et Mepilex Border® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB

#### Sélection Mepilex Border

N° réf.	Taille cm	Qté/boîte	Qté/caisse
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295000	12,5 x 12,5	5	50
295400	15 x 15	5	50
295600	15 x 20	5	45
295800	10 x 20	5	35
295900	10 x 30	5	25



CA129450801FR

NOUVEAU

# Mepilex® Border Sacrum

À compter du  
1<sup>er</sup> juin 2018

## Équipé de la technologie Deep Defense<sup>MD</sup> et de fonctionnalités d'utilisation améliorées

Mölnlycke a le plaisir de vous présenter le nouveau pansement Mepilex® Border Sacrum doté d'une performance supérieure et équipé de la technologie Safetac®. La nouvelle version de Mepilex® Border Sacrum offre désormais des fonctionnalités d'utilisation de qualité supérieure, notamment des bords plus épais ainsi que des languettes visuelles pour une manipulation optimale. La forme innovante de notre nouveau modèle permet également de couvrir les zones à hauts risques et aide à sceller le pansement dans la région interfessier.

Le pansement mousse Mepilex® Border Sacrum conserve sa constitution caractéristique à 5 couches ainsi qu'une structure matérielle et une structure de protection identiques. Il existe plus de 75 données probantes de qualité attestant de son efficacité individuelle dans le cadre de la prévention des plaies de pression.



### Le résultat avant tout

Des **bords perfectionnés** à l'épaisseur renforcée pour une manipulation plus efficace.<sup>1</sup>

Optimisation de la forme du pansement pour une **protection améliorée** des zones à haut risque des régions sacrées.<sup>1</sup>


**Les languettes visuelles** de manipulation fournissent des informations sur la position de maintien du pansement.

**Optimisation de la forme** du pansement pour améliorer la couverture des régions à hauts risques.<sup>1</sup>

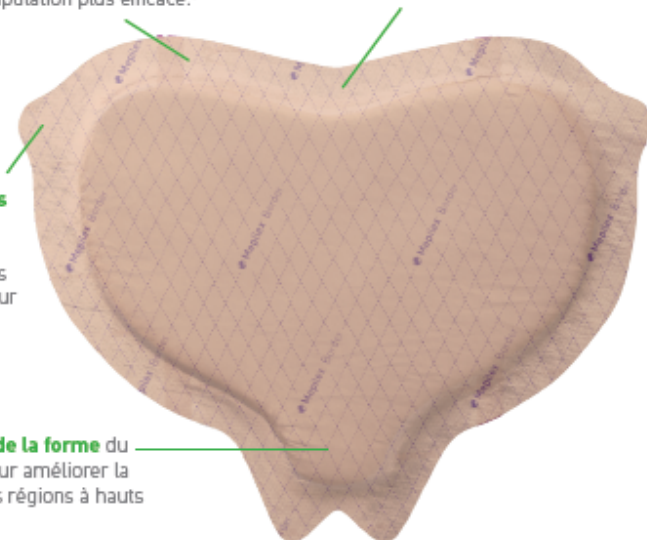

Une constitution protectrice unique en son **genre à 5 couches**

### Technologie propriétaire Deep Defense<sup>MD</sup>



La **force** caractérisant la direction de glissement/cisaillement du patient ainsi que la **flexibilité** apportée par la direction horizontale empêchent les effets conjugués des forces externes responsables des escarres et maintiennent l'intégrité structurale du pansement, même en cas d'absorption de la transpiration<sup>2</sup>.

<http://pup.molnlycke.com/>

#### Références:

1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMC5-2017-058) 2017. 2. Allen. Finite element analysis studying the effect of different prevention dressings on protecting soft tissues from high stresses and deformation. Ref No. 001. Data on file. 2017.

### Tableau de conversion - Nouveaux codes pour Mepilex® Border Sacrum

#### Gamme Mepilex® Border Sacrum (emballage stérile)

Code produit actuel	Nouveau code produit	Taille (cm)	Qté/Boîte	Qté/Caisse
282000	282010	16 x 20	<b>NOUVEAU</b> 10 Qté/Boîte	<b>NOUVEAU</b> 50 Qté/Caisse
282400	282410	22 x 25	<b>NOUVEAU</b> 10 Qté/Boîte	<b>NOUVEAU</b> 30 Qté/Caisse

Mepilex® Border Sacrum

Safetac<sup>®</sup>  
TECHNOLOGIE

Mölnlycke®

CFWC00751 B04



## Pansements absorbants en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M

### Conseils utiles pour l'utilisation du pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

1. Le pansement en acrylique n'est pas conçu pour être coupé. Au besoin, on peut tailler la bordure en pellicule avant d'enlever le cadre en papier.
2. Il n'existe pas de temps de port établi pour ce pansement. Changer le pansement en cas de fuite ou de décollement, ou en présence d'exsudat sous la bordure adhésive. La fréquence des changements de pansement dépend de facteurs comme le type de plaie, le volume d'exsudat, les protocoles de l'établissement et/ou les directives recommandées.
3. Sélectionner la taille de pansement appropriée et s'assurer que la compresse absorbante dépasse les bords de la plaie de 1 cm (3/8 po).
4. Les craquelures de la compresse absorbante ne nuisent pas à la capacité d'absorption du pansement.
5. Des bulles peuvent parfois se former sous la compresse du pansement. Celles-ci disparaissent à mesure que la compresse libère de la vapeur d'eau. Si les bulles ne disparaissent pas, il est peut-être temps de changer le pansement.
6. Au besoin, on peut faire chevaucher deux pansements de manière à couvrir une grande superficie ou plusieurs surfaces cutanées endommagées.
7. Pour retirer le pansement, saisir une de ses extrémités et tirer doucement, en éloignant le pansement de la peau pour l'étirer et faire décoller l'adhésif.

**Indications:** Déchirures cutanées, Plaies de pression, Abrasions et plaies superficielles, Zones donneuses, Brûlures superficielles, et Plaies en voie d'épithélisation peu exsudative

	<p>Les bords sont roulés, compromettant ainsi la barrière contre les virus et les bactéries.</p> <p><b>IL EST TEMPS DE CHANGER LE PANSEMENT!</b></p>		<p>L'exsudat est visible à l'intérieur de la compresse en acrylique et les bords demeurent scellés à la peau.</p> <p><b>LAISSER LE PANSEMENT EN PLACE!</b></p>
	<p>La compresse en acrylique au centre du pansement peut parfois sembler « craquelée ». C'est normal.</p> <p><b>LAISSER LE PANSEMENT EN PLACE!</b></p>		<p>L'exsudat est visible à l'intérieur de la compresse en acrylique et les bords demeurent scellés à la peau.</p> <p><b>LAISSER LE PANSEMENT EN PLACE!</b></p>
	<p>L'exsudat est visible à l'intérieur de la compresse en acrylique et les bords demeurent scellés à la peau.</p> <p><b>LAISSER LE PANSEMENT EN PLACE!</b></p>		<p>Le liquide de la plaie déborde de la compresse en acrylique et se répand sous la bordure du pansement.</p> <p><b>IL EST TEMPS DE CHANGER LE PANSEMENT!</b></p>


**3M**

Division des produits de soins de la peau et du traitement des plaies  
Compagnie 3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Canada  
1 800 364-3577  
www.3m.com/ca/healthcare

Soins de santé 3M/3M Health Care  
2510, Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 É.-U.

3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 3M, 2013. Tous droits réservés. 1307-01885F

Pr



## FLAMAZINE<sup>◇</sup>

Crème de sulfadiazine d'argent  
Norme du fabricant 1% p/p  
Antibactérien topique

**STÉRILE. SANS AGENT DE CONSERVATION**

### ACTION

Le mécanisme de l'action antibactérienne de la sulfadiazine d'argent n'a pas encore été complètement élucidé. On sait qu'une fois exposée au médicament, la structure de la membrane cellulaire de la bactérie se modifie; on assiste notamment à la déformation et au développement de la cellule et à l'affaiblissement de la paroi cellulaire. Ces changements s'accompagnent d'une viabilité réduite des souches sensibles due à l'entrave de la synthèse macromoléculaire. La portion de sulfadiazine possède également une action bactériostatique contre les micro-organismes sensibles. Chez l'adulte, jusqu'à 10 % de la sulfadiazine peut être absorbée, dont 60 à 85 % est excrétée dans l'urine. Chez les enfants dont les brûlures couvrent 13 % de la surface corporelle, la concentration de sulfadiazine dans l'urine était de 31,8 mg/L.

### INDICATIONS ET USAGES CLINIQUES

La (crème de sulfadiazine d'argent) FLAMAZINE est indiquée pour le traitement des ulcères de jambe, brûlures, greffes cutanées, incisions et autres lésions propres, abrasions, coupures et blessures légères. La crème FLAMAZINE est particulièrement indiquée dans le traitement et la prévention de l'infection chez les victimes de brûlures graves.

### CONTRE-INDICATIONS

On sait que le traitement aux sulfamides augmente les risques d'ictère nucléaire. La crème FLAMAZINE ne devrait donc pas être employée chez les femmes enceintes arrivées à terme, les prématurés ni les nouveau-nés au cours des premiers mois de vie. La crème FLAMAZINE ne devrait pas non plus être utilisée chez les malades que l'on sait sensibles à un de ses composants.

### MISES EN GARDE

La sensibilisation à la sulfadiazine d'argent appliquée localement est rarement prédite ou prouvée par des tests épicutanés. On fera donc preuve de prudence dans l'emploi de crème FLAMAZINE chez les individus ayant déjà manifesté des réactions aux sulfamides.

La crème de sulfadiazine d'argent doit être employée avec prudence chez les patients présentant des antécédents de déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase, car elle pourrait causer l'hémolyse. Lorsque la crème de sulfadiazine d'argent est administrée de façon prolongée ou sur des brûlures de grande surface, des quantités considérables de sulfadiazine d'argent sont absorbées. La concentration sérique de sulfadiazine d'argent peut alors atteindre les concentrations thérapeutiques de l'adulte (8 à 12 mg %).

La FLAMAZINE peut altérer l'apparence des plaies et ralentir le détachement de l'escarre dans les cas de brûlures.

### PRÉCAUTIONS

normale dans les jours qui suivent. Lorsque la crème de sulfadiazine d'argent est administrée de façon prolongée ou sur des brûlures de grande surface, l'absorption systémique d'argent peut causer des cas d'argyrie. De rares cas de problèmes rénaux ont été notés chez les malades utilisant la crème de sulfadiazine d'argent.

### Argyrie

Des évidences ont permis de démontrer que dans une grande plaie ou suite à une utilisation prolongée, l'absorption systémique d'argent peut se produire et causer l'argyrie.

### Sulfamides

Pendant le traitement de brûlures couvrant de grandes surfaces, il y a absorption systémique de quantités importantes de sulfadiazine d'argent. Par conséquent, des réactions indésirables associées aux sulfamides (incluant les problèmes rénaux) sont susceptibles de se produire.

### SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE

Chez les grands brûlés ou chez les malades manifestant des symptômes d'une absorption excessive, on doit maintenir un bilan hydrique optimal, non seulement pour prévenir la déshydratation, mais aussi pour prévenir les troubles rénaux.

### POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

#### Brûlures

On doit nettoyer les brûlures et recouvrir toutes les surfaces atteintes d'une couche de 3 à 5 mm de crème FLAMAZINE. On peut notamment appliquer la crème à l'aide d'un gant et/ou d'une spatule stériles. Au besoin, on remplacera la crème disparue au cours des activités du malade. On répétera l'application de la crème FLAMAZINE au moins toutes les 24 heures.

#### Brûlures aux mains et blessures aux doigts

L'une des méthodes ayant donné de bons résultats consiste à enduire la brûlure de crème FLAMAZINE, puis à enfermer la main dans un gant ou sac en plastique transparent que l'on ferme au poignet. On encouragera le malade à bouger la main et les doigts. Le pansement doit être renouvelé aux trois jours ou lorsqu'un exsudat abondant s'est accumulé dans le sac.

#### Ulcères de jambe


L'une des méthodes consiste à remplir la cavité de l'ulcère avec la crème FLAMAZINE en couche d'au moins 3 à 5 mm, en prenant soin de ne pas étaler de crème sur les régions saines. On recouvrira ensuite la crème d'une compresse hydrophile ou d'un pansement de gaze, et d'un bandage compressif selon l'ulcère. Le pansement doit être renouvelé tous les deux ou trois jours, en nettoyant et en débridant la plaie avant d'appliquer la crème. Il n'est pas recommandé d'utiliser la crème FLAMAZINE sur des ulcères de jambe fortement exsudatifs. Le contenant de crème FLAMAZINE doit être réservé à l'usage d'un seul patient.

### RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Nom commercial : Crème FLAMAZINE

Dénomination commune : Sulfadiazine d'argent

Formule développée :



## PRÉCAUTIONS

La (crème de sulfadiazine d'argent) FLAMAZINE doit être employée avec prudence chez les malades souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale importante étant donné que les deux peuvent réduire l'élimination du sulfadiazine absorbé. On a signalé des cas de leucopénie consécutifs à l'emploi de la sulfadiazine d'argent, surtout chez des patients brûlés sur de grandes surfaces. Cet effet, qui peut être relié au médicament, se produit souvent deux ou trois jours après le début du traitement et se résout généralement spontanément. Règle générale, il n'y a pas lieu d'interrompre le traitement à la crème FLAMAZINE, car le nombre de leucocytes redevient normal en quelques jours. On surveillera toutefois la leucocytose de près.

## Grossesse et allaitement

L'innocuité de la FLAMAZINE chez la femme enceinte ou qui allaite n'a pas été établie. On ne l'emploiera donc que chez les femmes enceintes gravement brûlées, si les bienfaits escomptés pour la mère dépassent les risques pour le fœtus. Par ailleurs, elle ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte touchant au terme de sa grossesse. (Voir *CONTRE-INDICATIONS*). La concentration de sulfamides dans le lait maternel est de 15-35 % celle dans le sérum. Puisque les sulfamides augmentent l'incidence d'ictère nucléaire, on fera preuve de prudence chez les femmes qui allaitent.

## Interactions médicamenteuses

### Agents de débridement enzymatique

Comme la FLAMAZINE peut inactiver les agents de débridement enzymatique, leur emploi concomitant peut s'avérer inapproprié.

### Hypoglycémisants et phénytoïne administrés par voie orale

Chez les grands brûlés dont les concentrations sériques de sulfadiazine se rapprochent des concentrations thérapeutiques, l'action des hypoglycémisants et de la phénytoïne par voie orale peut être activée; on recommande donc de surveiller les concentrations sanguines. L'administration simultanée de cimétidine peut augmenter l'incidence de leucopénie chez les patients brûlés sur de grandes surfaces.

## EFFETS SECONDAIRES

Des réactions isolées telles que sensations de brûlure, démangeaisons et rash (eczéma ou dermatite) peuvent se manifester chez environ 2% des malades.

### Leucopénie

On a signalé chez 3 à 5 % des malades, des cas de leucopénie dans les 48 à 72 heures après le début du traitement à la crème FLAMAZINE. Cet effet est généralement passager et se résout généralement spontanément. L'arrêt du traitement à la FLAMAZINE n'est habituellement pas nécessaire bien qu'un suivi de la numération globulaire doit être fait afin de s'assurer du retour à la

Dénomination chimique : Argent 2-(4-aminobenzènesulfamide)-pyrimidine

Formule moléculaire :  $C_{10}H_9N_4O_2S\ Ag$

Poids moléculaire : 357,14

## Présentation

La crème FLAMAZINE est une crème blanche, offerte en pots de 500 g et en tubes de 20 g et 50 g. Elle doit être conservée entre 8° et 25°C. Afin d'assurer la stérilité, les pots de 500 g devraient être jetés 24 heures après l'ouverture et les tubes de FLAMAZINE, 7 jours après l'ouverture.

## PHARMACOLOGIE

La libération lente de la sulfadiazine d'argent a pour effet de minimiser la déplétion rapide du chlorure et les déséquilibres électrolytiques qui y sont associés. La sulfadiazine d'argent n'est pas inhibée par le PABA. Lors d'études menées sur des porcs brûlés, l'absorption d'argent était inférieure à 1 % de la dose appliquée, alors que celle de la sulfadiazine était de 5 à 8 %. L'argent pénètre très faiblement sous les couches extérieures de la plaie et la plus grande partie de l'argent absorbé se retrouve dans le foie. En outre, on a mesuré de fortes concentrations d'argent dans la bile, ce qui permet de présumer que la portion d'argent est excrétée par voie hépato-biliaire. La portion de sulfadiazine est quant à elle excrétée par les reins.

Les concentrations sériques de sulfadiazine obtenues chez des brûlés ayant reçu de 500 à 1000 g de sulfadiazine d'argent à 1 % (correspondant à 5 à 10 g de sulfadiazine d'argent) étaient de 2 à 5 mg/L et les concentrations urinaires, de 60 à 1000 mg/L. L'excrétion urinaire quotidienne de la sulfadiazine était de 100 à 200 mg, soit moins de 5 % de la quantité de sulfadiazine d'argent appliquée.

La concentration de sulfadiazine dans l'exsudat des brûlures était de 900 à 1000 mg/L 24 heures après l'application, soit environ vingt fois la concentration inhibitrice minimale des bactéries sensibles (50 mg/L).

Dans une étude portant sur 23 patients, les concentrations sériques moyennes d'argent étaient passablement supérieures à la normale, alors que l'excrétion urinaire d'argent était manifestement élevée (0,402 mg/24 heures). Les six sujets brûlés sur 60 % ou plus de la surface corporelle ont présenté une excrétion de pointe moyenne de 1,100 mg/24 heures (environ 1000 fois la normale). On n'a constaté de toxicité de l'argent chez aucun des patients.

Fabriqué en Espagne. Distribué par Smith & Nephew Inc., 2250 Alfred Nobel, St. Laurent (Québec) Canada H4S 2C9.

®Marque déposée de Smith & Nephew

11402 SAPI060635



## Guide d'application et d'utilisation

### Indications

- Aide à protéger la plaie et à réduire la charge microbienne du milieu de la plaie.
- Retarde la formation d'escarres et aide la lésion à conserver une consistance molle et souple.  
(Ne pas appliquer plus de 50 g à la fois ou 150 g au total en une semaine.)

### Utilisation de la pâte et de l'onguent IODOSORB

Changements par semaine	1 x 3 g	2 x 3 g	3 x 3 g	1 x 5 g	2 x 5 g	3 x 5 g	1 x 10 g	2 x 10 g	3 x 10 g	1 x 15 g	2 x 15 g	1 x 20 g	2 x 20 g	3 x 20 g
1	3 g	6 g	9 g	5 g	10 g	15 g	10 g	20 g	30 g	17 g	34 g	20 g	40 g	60 g
2	6 g	12 g	18 g	10 g	20 g	30 g	20 g	40 g	60 g	34 g	68 g	40 g	80 g	120 g
3	9 g	18 g	27 g	15 g	30 g	45 g	30 g	60 g	90 g	51 g	102 g	60 g	120 g	180 g
4	12 g	24 g	36 g	20 g	40 g	60 g	40 g	80 g	120 g	68 g	136 g	80 g	160 g	240 g
5	15 g	30 g	45 g	25 g	50 g	75 g	50 g	100 g	150 g	85 g	170 g	100 g	200 g	300 g
6	18 g	36 g	54 g	30 g	60 g	90 g	60 g	120 g	180 g	102 g	204 g	120 g	240 g	360 g
7	21 g	42 g	63 g	35 g	70 g	105 g	70 g	140 g	210 g	119 g	238 g	140 g	280 g	420 g

Quantité maximale par jour = 50 g


Quantité maximale par semaine = 150 g

Il ne faut pas faire plus de changements que ce qui est indiqué, car cela entraînerait l'application d'une quantité supérieure à la dose maximale d'iode permise.



### Application de la pâte IODOSORB

1. Choisir un pansement adapté aux dimensions de la plaie.  
5 g pour une plaie de 6 cm x 4 cm (1/2 po x 2 3/8 po) ou moins  
10 g pour une plaie de 8 cm x 6 cm (2 2/8 po x 3 po) ou moins
2. Nettoyer la plaie et la peau avoisinante à l'aide d'un jet doux de solution saline ou d'eau. NE PAS SÉCHER.
3. Retirer la gaze recouvrant un seul côté ou les deux côtés de la pâte IODOSORB.
4. Appliquer la pâte IODOSORB sur la plaie. La pâte peut être mouillée ou coupée afin de l'adapter à la forme de la plaie. Jeter l'excédent de produit. Recouvrir d'un pansement secondaire ALLEVYN®.
5. Ne pas utiliser pendant plus de trois mois au cours d'un même traitement.



### Changement de la pâte IODOSORB

1. Changer la pâte IODOSORB lorsqu'elle est saturée d'exsudat, c'est-à-dire lorsque la couleur s'estompe, habituellement deux à trois fois par semaine, ou chaque jour si la plaie coule abondamment.
2. Imbibber le pansement d'eau stérile ou de solution saline pendant quelques minutes, puis l'enlever.
3. Enlever délicatement la pâte IODOSORB à l'aide d'un jet doux de solution saline ou d'eau stérile ou d'un écouvillon stérile.
4. Éponger doucement l'excès de liquide, en laissant la surface de la plaie légèrement humide, puis appliquer à nouveau la pâte IODOSORB.

### Renseignements pour les commandes

#### Pâte de cadexomère d'iode IODOSORB

Code	Description	Quantité
66060633	5 pansements	5 g – 4 x 6 cm
66060634	3 pansements	10 g – 6 x 8 cm
66060635	2 pansements	17 g – 8 x 10 cm

#### Onguent de cadexomère d'iode IODOSORB


Code	Description	Quantité
66060630	4 tubes	10 g
66060631	2 tubes	20 g
66060632	1 tube	40 g

### Application de l'onguent IODOSORB

1. Nettoyer la plaie et la peau avoisinante en profondeur à l'aide d'un jet doux de solution saline ou d'eau stérile. Éponger l'excès de liquide de façon à laisser la surface de la plaie légèrement humide.
2. Enlever le bouchon et utiliser l'envers pour perforer le sceau du tube. Étaler une couche d'onguent IODOSORB de 0,32 cm à 0,64 cm (1/8 po à 1/4 po) d'épaisseur sur une gaze stérile sèche de façon à couvrir toute la surface de la plaie. L'application d'une plus grande quantité d'onguent n'est pas nécessaire, mais pas problématique.
3. Après avoir enfilé des gants, placer la gaze sur la plaie.
4. Il ne faut pas appliquer plus de 50 g (1,8 oz) d'onguent à la fois ou plus de 150 g (5,3 oz) par semaine.

Pour le traitement d'ulcères variqueux, utiliser des bandages de compression en plus de l'onguent IODOSORB.

Jeter le reste du contenu du tube après l'application.



### Changement de l'onguent IODOSORB

- À chaque changement de pansement, il faut délicatement enlever l'onguent IODOSORB restant sur la surface de la plaie ou de l'ulcère avec une solution nettoyante appropriée (eau stérile ou solution saline) ou à l'aide d'un écouvillon stérile mouillé.
1. Changer l'onguent IODOSORB trois fois par semaine ou lorsqu'il passe du brun au jaune gris.
  2. Enlever délicatement l'onguent IODOSORB à l'aide d'un jet doux de solution saline ou d'eau stérile et d'un écouvillon stérile, au besoin.
  3. Éponger doucement l'excès de liquide, en laissant la surface de la plaie légèrement humide, puis appliquer à nouveau l'onguent IODOSORB. Réduire le nombre d'applications à mesure que la quantité d'exsudat diminue.



Smith & Nephew, Inc.

États-Unis  
970 Lake Carillon Drive  
Suite 110  
St. Petersburg, FL 33716  
Customer Care Center  
1-800-876-1261  
Tél. : 727-392-1261  
Télex : 727-392-6994

Canada  
2280 Argentea Road  
Mississauga (Ontario)  
L5N 6H8  
Centre d'action clients  
Tél. : 1-800-463-7439  
Télex : 1-800-671-9540

www.smith-nephew.com  
www.iodosorb.com  
www.iodosorb.com

©2013 Smith & Nephew, Inc. Tous droits réservés.  
"Marque de commerce de Smith & Nephew.  
Certaines marques sont inscrites au registre  
américain des brevets et des marques de commerce.  
RA 100 IOBE-01-1212-CAF

## CONTRE-INDICATIONS

IODOSORB est contre-indiqué chez les patients dont la sensibilité à l'iode est connue ou soupçonnée, qui sont atteints de thyroïdite de Hashimoto ou de goitre multinodulaire non toxique ainsi que chez les enfants.

### Mises en garde

#### Interactions médicamenteuses

Il existe un risque d'interaction avec le lithium s'accompagnant d'une possibilité accrue d'hyperthyroïdie. Le cadexomère d'iode ne doit pas être appliqué en concomitance avec des antiseptiques.

#### Effets du médicament sur les résultats d'épreuves de laboratoire

Comme l'iode peut être absorbé par la voie systémique, on doit tenir compte de son éventuelle incidence sur les résultats des tests de la fonction thyroïdienne.

### Précautions

L'iode peut être absorbé par la voie systémique, particulièrement si les plaies traitées sont étendues. Les patients qui ont une insuffisance rénale grave ou des antécédents de troubles thyroïdiens sont plus susceptibles de présenter une altération du métabolisme thyroïdien à la suite d'un traitement au cadexomère d'iode de longue durée. Des cas isolés d'hyperthyroïdie associés à l'iode exogène ont été signalés chez des patients atteints de goitre endémique.

On a observé qu'une croûte adhérente peut se former lorsque les pansements à la pâte de cadexomère d'iode ne sont pas changés assez souvent.

### Grossesse et allaitement

L'iode traverse la barrière placentaire et est sécrété dans le lait maternel. Les essais cliniques sur le cadexomère d'iode pendant la grossesse étant limités, on doit éviter de l'employer chez les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.

### Effets indésirables

Environ 5 % des patients traités au cadexomère d'iode ressentent une sensation de brûlure ou une douleur passagère dans l'heure qui suit l'application. On a signalé de rares cas d'allergie de contact, d'altération de la fonction thyroïdienne et d'œdème local. Une enflure ou un rougissement de faible importance peut se produire au pourtour de la plaie sans qu'il s'agisse nécessairement d'une réaction allergique.

### Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été signalé.


#### Symptômes et traitement

En cas d'utilisation topique excessive de cadexomère d'iode, le traitement devra être interrompu, la région devra être lavée et un traitement symptomatique devra être instauré.

## Guide de mesure et d'application de l'onguent de collagénase SANTYL<sup>®</sup>

Les illustrations ci-dessous servent de référence et ne doivent pas remplacer un avis clinique ni les protocoles des établissements.

Tube de 30 g : 3,04 cm (1,20 po) = environ 1 g<sup>1</sup>




### 1 NETTOYER



- » Retirer autant de débris libres que possible de la plaie.
- » Nettoyer délicatement le lit de la plaie avec une solution saline stérile ou avec un nettoyant approprié (pH idéal entre 6 et 8), et ensuite avec une solution saline, à chaque changement de pansement.
- » Si nécessaire, inciser l'escarre à l'aide d'une lame n° 11 pour accélérer le débridement.

### 2 APPLIQUER



- » Appliquer l'onguent directement sur la plaie ou sur une gaze stérile qui est ensuite appliquée sur la plaie et retenue adéquatement.
- » Appliquer une épaisseur de 2 mm d'onguent de collagénase SANTYL (environ l'épaisseur d'une pièce de monnaie) sur la région affectée.
- » Appliquer une fois par jour (ou plus souvent si le pansement devient souillé, en raison d'incontinence, par exemple).

### 3 PANSER



- » L'enzyme collagénase s'active naturellement s'il y a suffisamment d'exsudat, mais une plaie sèche peut avoir besoin d'être humidifiée.
- » La plaie est recouverte d'un pansement approprié, comme ALLEVYN<sup>®</sup>. Ne pas utiliser de pansement contenant de l'argent (Ag) ou de l'iode (I<sub>2</sub>) avec l'onguent de collagénase SANTYL puisque ces ions rendent la collagénase (enzyme actif de l'onguent SANTYL) inactive.

#### Si une infection se développe :

- » En cas d'infection (présence de cultures positives, de pus, d'inflammation ou d'odeur), il est préférable d'utiliser un agent antibactérien adéquat.
- » Si l'infection ne réagit pas au traitement, l'utilisation de l'onguent de collagénase SANTYL devrait être interrompue jusqu'à ce que l'infection se résorbe.

#### Référence

1. Données au dossier. Smith & Nephew, Inc., 2014.

Smith & Nephew Inc.  
2280, chemin Argentea  
Mississauga (ON)  
L5N 6H8 Canada

www.smith-nephew.com/fr-canada  
www.santyl.ca

\* marque de commerce de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew, mai 2015

T 1-800-463-7439  
F 1-800-671-9140

SNIL-SA-1503FR (CA/79607)



**Santyl® Collagénase Onguent  
250 unités/g**

**Favorise la guérison naturelle**

**DESCRIPTION:** Santyl® (collagénase) onguent est un agent de débridement topique stérile enzymatique qui renferme 250 unités de collagénase par gramme de pétrolatum blanc U.S.P. L'enzyme collagénase est dérivée de la fermentation de *Clostridium histolyticum* possédant le pouvoir unique de digérer de manière sélective le collagène aussi bien naturel que dénaturé qui lie les fibres nécrosées à la surface de la plaie.

**PHARMACOLOGIE CLINIQUE:** Santyl® (collagénase) a la capacité de digérer le collagène insoluble, non dénaturé et dénaturé, par clivage de la liaison peptidique à un pH et à une température physiologiques. Cette caractéristique le rend particulièrement efficace dans l'élimination des déchets des lésions dermiques favorisant ainsi la formation du tissu de granulation et l'épithélialisation ultérieure des zones dermiques ulcérées et gravement brûlées. Le collagène des tissus sains ou du nouveau tissu de granulation n'est pas digéré.

**INDICATIONS:** Santyl® (collagénase) est un onguent stérile indiqué pour le débridement des zones dermiques ulcérées ou gravement brûlées.

**CONTRE-INDICATIONS:** L'application est contre-indiquée chez les patients ayant présenté une hypersensibilité locale ou systémique à la collagénase.

**MISE EN GARDE:** Les patients atteints de conditions débilantes doivent être surveillés étroitement pour éviter la généralisation des infections bactériennes. Les enzymes de débridement augmenteraient le risque de bactériémie.

**PRÉCAUTIONS:** Le pH optimal de l'enzyme est de 6 à 8. Un pH nettement inférieur à un effet nettement adverse sur l'action de l'enzyme et des précautions appropriées doivent alors être prises. L'action de l'enzyme est également contrariée par les détergents, l'hexachlorophène et les ions de métaux lourds, comme le mercure et l'argent, présents dans certains antiseptiques, et par le cobalt, le magnésium et le manganèse. Quand on soupçonne l'utilisation de ces produits, la zone affectée doit être soigneusement nettoyée par des lavages répétés avec un soluté physiologique stérile avant l'application de l'onguent Santyl® (collagénase). Les bains contenant des ions de métaux ou des solutions acides comme la solution de Burow doivent être évités en raison de l'ion métal et du faible pH. Les solutions nettoyantes comme le soluté de Dakin suivi d'un soluté physiologique stérile n'entravent pas l'action de l'enzyme. L'application de l'onguent doit se limiter à la zone affectée pour éviter le risque possible d'irritation ou de macération de la peau saine. Cependant, l'enzyme n'altère pas le nouveau tissu de granulation. Un érythème bénin dans le tissu avoisinant pourrait se produire. Cela peut facilement être évité en protégeant la peau saine avec un produit comme de la pâte d'oxyde de zinc. Compte tenu de la nature protéique de l'enzyme présent dans le médicament, son emploi prolongé pourrait amener une sensibilisation.

**EFFETS SECONDAIRES:** Bien qu'aucune sensibilité allergique ni réaction toxique n'aient été notées à ce jour dans les comptes rendus d'études, on a signalé un cas de manifestations systémiques d'hypersensibilité chez un patient traité pendant plus d'un an avec une association de collagénase et de cortisone. On a noté de l'irritation, de la macération ou de l'érythème dans le cas de contact prolongé de la peau normale avec l'onguent Santyl® (collagénase), soit par application de l'onguent sur les régions normales de la peau, soit par application excessive de l'onguent dans le cratère de la plaie, permettant à celui-ci de s'étendre à la peau normale lors de l'application des pansements. L'incidence signalée de ce type de réaction était de 1,8%.

**SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE: Symptômes:** Jusqu'ici, l'irritation, la macération ou l'érythème signalés en cas de contact prolongé de la peau saine avec l'onguent Santyl® (collagénase) représentent les seuls symptômes signalés de surdosage. **Traitement:** On peut rendre l'onguent Santyl® (collagénase) inerte en appliquant la solution de Burow U.S.P. (pH 3.6-4.4) sur la plaie. La réapplication du produit, si elle est considérée nécessaire, ne se fera qu'avec prudence.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Pour usage externe seulement. L'onguent Santyl® (collagénase) doit être appliqué une fois par jour ou plus fréquemment si le pansement se souille (à cause d'incontinence par exemple) de la façon suivante: **(1)** Avant application, les lésions doivent être nettoyées doucement avec une gaze saturée d'un soluté physiologique stérile pour enlever toute pellicule et toute matière digérée. Si l'on a besoin d'une solution nettoyante plus puissante, on peut utiliser le soluté de Dakin suivi d'un soluté physiologique stérile. **(2)** En cas d'infection, révélée par la présence de cultures positives, de pus, d'une inflammation ou d'une odeur, il serait souhaitable d'employer un agent antibactérien approprié. Il faut interrompre le traitement au Santyl® (collagénase) jusqu'à rémission de l'infection, si l'infection ne se résorbe pas. **(3)** Appliquer Santyl® (collagénase) directement sur les blessures profondes à l'aide d'un abaisse-langue ou d'une spatule. Pour les plaies superficielles, appliquer l'onguent sur une compresse non adhérente ou un pansement transparent à être déposés sur la plaie; puis recouvrir d'un pansement approprié telle une compresse de gaze stérile déquatement retenue. **(4)** L'utilisation d'un pansement occlusif ou semi-occlusif peut favoriser le ramollissement de l'escarre, le cas échéant. Ou, si l'on hachure une escarre épaisse à l'aide d'une lame numéro 11, on peut accélérer le débridement. Nettoyer alors avec une solution saline stérile. Il est également souhaitable d'enlever autant de débris lâches que possible à l'aide de pinces et de ciseaux. **(5)** Enlever tout excès d'onguent à chaque renouvellement du pansement. **(6)** Il faut cesser l'utilisation de l'onguent Santyl® (collagénase) lorsque le débridement des tissus nécrotiques est complet et que la granulation est bien entamée.

**PRÉSENTATION:** Disponible en tubes de 15 et 30 grammes d'onguent. Stérile dans l'emballage non ouvert. Aucun agent de conservation. Ne pas entreposer au-dessus de 25°C. Monographie du produit sur demande.



## Soins de plaies avancés de Covidien Pansement de gaze antimicrobien Kerlix<sup>MC</sup> AMD

### Pansement de gaze antimicrobien Kerlix<sup>MC</sup> AMD

0,2 % de polyhexaméthylène biguanide ou PHMB

Code	Description	Qté/caisse
3331	11,4 cm x 3,7 m dans un contenant de plastique rigide	60
3332	11,4 cm x 3,7 m dans un sachet souple	100

### Pansement de gaze antimicrobien Kerlix<sup>MC</sup> AMD

0,2 % de polyhexaméthylène biguanide ou PHMB

Code	Description	Par plateau	Qté/caisse
6662	Sachet souple stérile de 2, moyen (15 cm x 17 cm)	40	480
6665	Sachet souple stérile de 5, moyen (15 cm x 17 cm)	50	600
6660	Plateau de plastique stérile de 10, moyen (15 cm x 17 cm)		480



### Indications

- Infections des plis cutanés
- Plaies chirurgicales
- Plaies aiguës et chroniques
- Zones difficiles à panser
- Plaies de grande surface

### Mode d'emploi

#### Préparation et application du pansement

- Préparer le lit de la plaie selon le protocole de l'établissement.
- Couper le pansement à la taille désirée, le cas échéant, pour obtenir une application lisse et uniforme à la surface de la peau.
- Rouler l'extrémité coupée pour s'assurer qu'aucune fibre ne se libère, *ou* laisser l'extrémité coupée hors de la plaie à la surface du pansement.
- Si la fragilité de la peau autour de la plaie ou la macération est une source de préoccupation, protéger cette région selon le protocole de l'établissement.
- Les rouleaux Kerlix<sup>MC</sup> AMD peuvent être appliqués secs ou humides selon les applications. Consulter les protocoles de l'établissement et les concepts de cicatrisation en milieu humide.

#### Fréquence de changement des pansements

- La fréquence de changement des pansements dépend de la nature et de l'état de la plaie et du drainage.
- Veuillez suivre les protocoles de changement des pansements de l'établissement.
- Kerlix<sup>MC</sup> AMD est efficace jusqu'à 3 jours.
- Pourrait nécessiter un pansement non adhésif (Telfa<sup>MC</sup> Clear) comme première interface avec la surface de la plaie.

#### Changement et retrait du pansement

- Le pansement Kerlix<sup>MC</sup> AMD doit être changé à l'apparition de signes de saturation ou après 3 jours.
- Pour changer le pansement Kerlix<sup>MC</sup> AMD, retirer délicatement le pansement de la plaie.
- Jeter le pansement et préparer le lit de la plaie selon le protocole de l'établissement.

#### Contre-indication

- Ne pas utiliser avec une solution de Dakin ni chez les patients ayant une sensibilité connue au PHMB.



Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez contacter votre représentant de vente local de Covidien.


COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2014 Covidien.  
Fabriqué par : Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA, É.-U., 02048  
CDN-M00041-F Rev. 2014/08

8455, AUT. TRANSCANADIENNE 1-877-664-8926 [TÉL]  
SAINT-LAURENT (QUÉBEC) 1-800-567-1939 [TÉLÉC]  
H4S 1Z1 WWW.COVIDIEN.COM

## Pansement mousse Hydrofera Blue CLASSIC


GUIDE D'UTILISATION  
DU PRODUIT

### Hydrater



- Hydrater avec une solution saline ou de l'eau stérile.
- Essorer l'excédent de liquide du pansement.
- Pansement pour drainage élevé: laisser tremper pendant 10 minutes.

### Appliquer



- Plaie superficielle :
- Le pansement peut être coupé pour s'ajuster au lit de la plaie.
  - Si les bords de la plaie sont roulés, le pansement devrait couvrir la plaie et la peau périlésionnelle.
- Plaie profonde :
- Comblent librement la cavité, le sous-minage, la fistule ou le tunnel à l'aide du pansement.

### Couvrir



- Le choix du pansement secondaire est basé sur le niveau d'exsudat (voir tableau ci-dessous).

### Changement de pansement



- Changer le pansement à tous les 3 jours ou plus fréquemment au besoin:
  - Si une portion du pansement est blanche lorsque vous le retirez, vous devez changer celui-ci plus fréquemment pour conserver l'effet antibactérien optimal. Si celui-ci est bleu, vous pouvez garder le pansement en place pour une période pouvant aller jusqu'à trois jours.

### Équilibre hydrique




- Comme pour de nombreux pansements, l'équilibre hydrique est essentiel. Si le pansement est sec, réhumecter complètement avec une solution saline ou de l'eau stérile, puis retirer délicatement le pansement.

### Pansement tunnel



- Humecter l'extrémité avec une solution saline ou de l'eau stérile pour faciliter l'insertion. Seulement le quart du produit devrait être humide. Le reste doit demeurer sec et rigide pour faciliter l'insertion du pansement.
- Insérer délicatement l'extrémité humide dans le tunnel de la plaie. Au besoin, un coton-tige peut être utilisé pour vous aider à l'insertion.
- Une fois inséré, humecter la partie rigide du pansement jusqu'à ce que celle-ci soit humide.
- Couper le pansement au besoin.
- Couvrir à l'aide d'un pansement secondaire approprié en fonction de l'exsudat de la plaie.

### Sélection du pansement secondaire



## NOM DU PRODUIT

### **PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup>**

Matrice pour l'équilibre de la plaie

## CATÉGORIE DE PRODUIT

Régulateur de l'activité protéasique

## COMPOSANTES DU PRODUIT

La matrice pour l'équilibre de la plaie PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> est un dispositif médical stérile composé d'un tampon lyophilisé, à pores ouverts, blanc ou blanc cassé et de forme hexagonale, fait de cellulose oxydée régénérée (COR) et de COR-argent.

## DESCRIPTION DU PRODUIT / MODE D'ACTION ET BIENFAITS CLINIQUES

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> propose un traitement interactif de la plaie administré par voie topique. En présence d'exsudat, la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> se transforme en un gel doux et biodégradable qui entre en contact facilement avec toutes les zones de la plaie. En l'absence d'exsudat, il faut utiliser une solution saline pour hydrater la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup>.

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> régule et équilibre l'environnement de la plaie grâce à l'association unique de trois modes d'action :

1. Le pansement absorbe l'exsudat, y compris les protéases
2. Le collagène se lie aux métalloprotéinases matricielles et les inactive
3. La COR se lie à l'élastase et l'inactive

L'argent procure une protection antimicrobienne additionnelle.

## INDICATIONS

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> est indiquée dans la prise en charge de tous les types de plaies de cicatrisation de deuxième intention qui ne présentent pas de tissus nécrosés, y compris :

- Les ulcères diabétiques
- Les ulcères veineux
- Les escarres
- Les ulcères à causes vasculaires mixtes
- Les plaies traumatiques ou chirurgicales

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> a des propriétés hémostatiques connues.

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> peut être utilisée sous compressothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS<sup>1</sup>

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux composants du produit (COR, collagène et argent). Interrompre l'usage de la matrice à l'apparition de tout signe de sensibilité.

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> n'est pas indiquée chez les patients présentant des brûlures importantes.

## PRÉCAUTIONS

Un traitement antimicrobien systémique doit être envisagé à la manifestation de signes d'une infection de la plaie. La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> peut être utilisée en association avec des antibiotiques systémiques, sous supervision médicale.

Les cliniciens et les professionnels de la santé doivent être conscients qu'il n'y a que très peu de données concernant l'usage prolongé et répété des pansements contenant de l'argent, particulièrement chez les enfants et les nouveau-nés.

## ENTREPOSAGE

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> doit être entreposée à l'abri de la lumière. Une exposition excessive à la lumière peut entraîner une décoloration, sans toutefois affecter l'efficacité du produit.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du site

Avant le traitement, il faut d'abord retirer tout tissu abîmé (comme les tissus nécrosés) par débridement chirurgical, enzymatique ou autolytique.

### Application du pansement

Pour un effet optimal, appliquer la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> directement sur l'ensemble du lit de la plaie.

En présence d'une plaie faiblement exsudative, ou en absence d'exsudat, appliquer la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> et l'hydrater au moyen d'une solution saline ou d'une solution de Ringer afin de lancer le processus de gélification.

Après avoir été hydratée, la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> entrera en contact étroit avec la plaie.

Le gel biodégradable est naturellement absorbé avec le temps.

La matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> doit être recouverte de gaze ou d'un pansement non adhérent ou hydro polymère afin de maintenir un environnement humide propice à la cicatrisation.

Après le traitement initial, recommencer le traitement avec la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> pendant jusqu'à 72 heures, selon la quantité d'exsudat.



#### FRÉQUENCE DE CHANGEMENT DES PANSEMENTS

Il n'est pas nécessaire de nettoyer la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> résiduelle en changeant le pansement, car elle sera naturellement absorbée par l'organisme avec le temps. Après le traitement initial, recommencer le traitement avec la matrice PROMOGRAN PRISMA<sup>MD</sup> pendant jusqu'à 72 heures, selon la quantité d'exsudat.

Consulter le feuillet à l'intérieur de l'emballage pour le mode d'emploi complet.

Ne pas réutiliser. Ne pas stériliser à nouveau.

#### CONDITIONNEMENT ET ENTREPOSAGE

Entreposer le produit à une température inférieure à 25 °C.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Contient de la COR-argent. Conserver le produit dans son emballage, à l'abri de la lumière.

#### CODES DE PRODUIT ET DIMENSIONS

PROMOGRAN <sup>MD</sup>		
Dimensions	Quantité de pansements par boîte	Code Systagenix
28 cm <sup>2</sup>	10	PS2028
123 cm <sup>2</sup>	10	PS2123

# SurePress®

## Éliminez les incertitudes et augmentez votre confiance

Le bandage de forte compression extensible SurePress® est conçu pour être appliqué sur un pansement primaire chez les patients atteints d'un trouble du retour veineux et pour lesquels un traitement par compression est indiqué.



### Traitement par **compression**

- Une compression adéquate est nécessaire afin de favoriser la cicatrisation des ulcères veineux
- Les indicateurs visuels d'application vous aident à exercer une force appropriée de compression graduelle
- Conçu pour exercer une compression soutenue de 35 à 45 mmHg

### Conçu pour **en faciliter l'application**

- Deux indicateurs rectangulaires pour des membres de différentes tailles
- Les rectangles se transforment en carrés lorsque l'extension appropriée est atteinte
- La ligne jaune au centre du bandage facilite un chevauchement de 50 %

### Conçu pour être **durable**

- Le bandage est réutilisable et léger
- Des tests ont montré que le bandage exerce une compression en toute sûreté jusqu'à 20 lavages (en utilisant seulement de l'eau, sans détergent)<sup>1</sup>

### Le bandage absorbant SurePress® est aussi disponible

- Ce bandage doux peut être appliqué sous le bandage de forte compression extensible SurePress®
- Il améliore la prise en charge de l'exsudat de la plaie
- Ce bandage facilite une distribution graduelle de la compression
- Le bandage absorbant facilite l'application sur des jambes de formes inhabituelles en protégeant les zones vulnérables et en aplanissant certains contours<sup>2</sup>

# Bandage de forte compression SurePress®

## Application\*

SurePress®

Au moyen d'un mètre à ruban, déterminer si le membre est de taille « normale » ou « forte ». Les chevilles dont le tour mesure de 18 à 26 cm sont considérées comme étant de tailles « normales ». Les chevilles dont le tour est supérieur à 26 cm sont considérées comme étant de tailles « fortes ».

Une fois la taille du membre déterminée, choisir le grand ou le petit indicateur d'extension rectangulaire sur le bandage. On doit choisir le petit rectangle pour un membre de taille « normale » et le grand pour un membre de taille « forte ».



1 Nettoyer l'ulcère conformément au protocole habituel de pratique clinique, puis bien rincer et assécher la peau environnante avant d'appliquer le pansement primaire et le bandage de compression.



4 Maintenir le bandage en place avec le pouce et commencer à l'enrouler autour du talon en l'étirant jusqu'à ce que le rectangle choisi se soit transformé en carré; puis, enrouler le bandage une fois autour du talon. Maintenir le bandage en place avec le pouce et l'étirer jusqu'à ce que le rectangle choisi se soit transformé en carré. Enrouler ensuite le bandage en passant sur le devant de la cheville et sous la plante du pied de façon à recouvrir l'écart.



2 Après l'application d'un pansement primaire, un bandage absorbant SurePress® (vendu séparément) peut être appliqué comme base avant l'application du bandage de compression. Cette compresse absorbante et douce aide à répartir une compression graduelle et à protéger la peau de tout exsudat qui passerait à travers du pansement primaire.



5 Continuer à étirer le bandage jusqu'à ce que le rectangle choisi se soit transformé en carré. Enrouler le bandage une fois autour de la cheville, puis continuer à l'enrouler en spirale le long de la jambe en le faisant chevaucher, à chaque tour, sur la moitié de sa largeur, c'est-à-dire à la base des indicateurs d'extension rectangulaires.



3 Commencer à enrouler le bandage au centre de l'avant-pied, la bordure inférieure du bandage se trouvant à la base des orteils. Enrouler le bandage autour du pied (1 ½ tour) en le tendant légèrement.



6 Lorsque le bandage recouvre toute la jambe jusqu'en dessous du genou, couper l'excès de bandage et en fixer solidement l'extrémité avec du ruban adhésif.

### Information pour commander

#### Bandage de forte compression SurePress®

Code de produit	Dimensions	Unité par boîte
650947	10 cm x 3 m (non étiré) (4 po x 3,2 verges)	1

#### Bandage absorbant SurePress®

Code de produit	Dimensions	Unité par boîte
650948	10 cm x 3 m (4 po x 3,2 verges)	6

Références : 1. Gust AF, Thomas S, Nelson K. SurePress high compression bandage: Design, performance and clinical experience. Affiche présentée à la réunion de CIBS/NIH, Bordeaux, France, 3. Slomay J. Graduated compression with a high compression bandage. Affiche présentée à l'INMA à Milan en 1997.

\* Consulter la notice du produit pour le mode d'emploi détaillé.

SurePress est une marque déposée de ConvaTec Inc.  
©2009 ConvaTec Inc. Décembre 2009 CA-07-1425-WF V832


Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Centre des relations avec la clientèle au 1 800 465-6502, du lundi au vendredi, de 8h à 18h (HNE), ou visitez notre site Web à [www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)




## Application sur une jambe forte

### 1<sup>re</sup> couche Couche de confort intérieure


On peut facilement adapter l'application du système de bandage compressif à 2 couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de manière à atteindre un niveau de compression soutenu et souple sur des membres de tailles et de formes variées.




Avec le pied en position de dorsiflexion, appliquer le bandage en commençant à l'enrouler à la base des orteils au niveau de la tête du cinquième métatarsien.




Le deuxième tour doit passer sur le dessus du pied de façon à ce que le milieu de la largeur du bandage couvre la malléole interne.




Faire passer ce tour derrière le talon, puis l'appliquer sur le dessus du pied, là où le bandage chevauche le matériau sous-jacent.



Couper le bandage et appuyer légèrement pour le fixer en place.



Appliquer la prochaine couche de bandage en l'enroulant à partir du bord coupé précédent. Avec un chevauchement minimal, enrouler le bandage autour de la jambe. Couper le bandage lorsqu'il chevauche la couche précédente.



En utilisant la même technique, remonter le long de la jambe en enroulant le bandage par tours individuels. Arrêtez le bandage au niveau de la tête du péroné ou juste sous l'arrière du genou. Couper le surplus de bandage. Exercer une légère pression sur l'extrémité du bandage et le long de la jambe pour s'assurer qu'il reste en place pendant l'application de la couche de compression.


Pour les patients qui tolèrent moins bien la compression, envisager d'utiliser le système de bandage compressif à 2 couches Coban<sup>MC</sup> Lite 3M<sup>MC</sup>.

## 2<sup>e</sup> couche


### Couche de compression extérieure




Appliquer cette couche en l'étirant au maximum pendant toute l'application. Tenir le rouleau près du pied et du membre pendant toute l'application pour obtenir une compression maîtrisée et uniforme. Avec le pied en position de dorsiflexion, appliquer le bandage en commençant à l'enrouler à la base des orteils au niveau de la tête du cinquième métatarsien.




En utilisant la technique du « motif en huit », ramener le rouleau sur le dessus du pied, le faire passer sous la plante du pied, puis remonter de manière à le faire passer derrière le talon. Effectuer deux ou trois motifs en huit autour de la cheville de manière à couvrir entièrement le talon.



Si cela est nécessaire pour que le bandage épouse mieux la forme du membre ou qu'il le recouvre plus uniformément, on peut couper la couche de compression, puis remonter le long du pied et de la jambe en l'enroulant par tours individuels avec un chevauchement de 50 %, en s'assurant d'exercer une pression suffisante pour bien mouler chaque couche subséquente.



Arrêter le bandage au niveau de la tête du péroné ou juste sous l'arrière du genou en l'alignant au bord supérieur de la couche de confort. Couper le surplus de bandage. Appuyer légèrement et lisser toute la surface du bandage.



### Retrait

Le système de bandage compressif à 2 couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> peut être enlevé avec des ciseaux pour bandage ou être déroulé.

### IPCB (indice de pression systolique cheville-bras)

Utilisez ce tableau-guide pour interpréter les valeurs de l'IPCB en rapport avec la compression.

		Pression systolique braohiale (mmHg)												
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
Pression systolique à la cheville (mmHg)	20	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	Ischémie très grave	
	30	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15		Ischémie grave
	40	0.40	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20		
	50	0.50	0.45	0.42	0.38	0.36	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	Ischémie modérée	
	60	0.60	0.55	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.32	0.30		
	70	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.47	0.45	0.41	0.39	0.37	0.35	Ischémie légère	
	80	0.80	0.73	0.67	0.62	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42	0.40		
	90	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.60	0.56	0.53	0.50	0.47	0.45	Normale	
	100	1.00	0.91	0.83	0.77	0.71	0.67	0.63	0.59	0.56	0.53	0.50		
	110	1.10	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.69	0.65	0.61	0.58	0.55		
	120	1.20	1.09	1.00	0.92	0.86	0.80	0.75	0.71	0.67	0.63	0.60		
	130	1.30	1.18	1.08	1.00	0.93	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.65		
140	1.40	1.27	1.17	1.08	1.00	0.93	0.88	0.82	0.78	0.74	0.70			
150	1.50	1.36	1.25	1.15	1.07	1.00	0.94	0.88	0.83	0.79	0.75			
160	1.60	1.45	1.33	1.23	1.14	1.07	1.00	0.94	0.89	0.84	0.80			
170	1.70	1.55	1.42	1.31	1.21	1.13	1.06	1.00	0.94	0.89	0.85			
180	1.80	1.64	1.50	1.38	1.29	1.20	1.13	1.06	1.00	0.95	0.90			
190	1.90	1.73	1.58	1.46	1.36	1.27	1.19	1.12	1.06	1.00	0.95			
200	2.00	1.82	1.67	1.54	1.43	1.33	1.25	1.18	1.11	1.05	1.00			

■ **IPCB < 0,5** : Ischémie très grave et grave  
■ Compression déconseillée

■ **IPCB de 0,5 à 0,8** : Ischémie modérée et légère

■ Système de bandage compressif à 2 couches Coban<sup>MC</sup> Lite 3M<sup>MC</sup>

■ **IPCB ≥ 0,8** : Normale

■ Système de bandage compressif à 2 couches Coban<sup>MC</sup> Lite 3M<sup>MC</sup>

■ Système de bandage compressif à 2 couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Énoncé de position sur l'utilisation de l'indice de pression cheville-bras dans l'évaluation des patients atteints d'une maladie vasculaire périphérique. Protocole d'accord établi par la division des normes de la Society of Interventional Radiology.

Un IPCB aussi élevé que 1,10 est normal. Les indices anormaux sont inférieurs à 1,0. La plupart des patients avec claudication présentent un IPCB qui varie de 0,3 à 0,9. Une douleur au repos ou une maladie occlusive grave est habituellement accompagnée d'un IPCB inférieur à 0,50. Les indices inférieurs à 0,20 sont le signe d'extrémités ischémiques ou nécrotiques.

Sacks, D., M.D. et col., *J. Vasc. Interv. Radiol.*, vol. 14 (2003), p. S389.

## Application du système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sur le pied et la jambe

### Matériau et positionnement

- Pour de nombreux patients, l'application complète sur la jambe doit se faire en deux étapes.
- Appliquez le bandage sur la partie inférieure de la jambe lorsque le patient est assis ou couche confortablement, puis demandez au patient de se lever pour appliquer le bandage sur la partie supérieure de la jambe.
- Pour profiter de tous les avantages de la compression, il est important que la jambe soit soutenue dans une position détendue pendant toute la durée de l'application.

- En présence d'une plaie, les pansements en mousse sont les plus efficaces pour la gestion de l'écoulement.
- Choisissez le couche confort en mousse et la couche de compression de 10 cm (4 po) du système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> pour la plupart des plaies inférieures des jambes.
- Utilisez un rouleau de couche confort en mousse et de couche de compression de 15 cm (6 po) ou de 20 cm (8 po) du système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> pour couvrir le genou et le coude.



### Application sous le genou

#### 1<sup>re</sup> couche :

##### Couche confort en mousse

- Placer le côté en mousse de cette couche contre la peau et la rendre juste assez pour épouser la forme de la jambe avec le moins de chevauchement possible.
- Recouvrir la peau avec une couche sans mousse que possible, sans laisser d'espaces.
- En présence de plaie ouverte (boursoite), utiliser des morceaux de couche confort en mousse rigides de manière que le côté en mousse soit à l'extérieur pour les séparer.



**Étape 1 :** Avec le pied en position de dorsiflexion (90°), appliquez le bandage en commençant à l'arrière de la base des orteils au niveau de la tête du crâne. Utilisez un rouleau de couche confort en mousse rigide pour obtenir un alignement exact et contrôlé du pied.



**Étape 2 :** La deuxième tour doit passer sur le dessus du pied de façon à ce que le milieu de la largeur de bandage recouvre le milieu de la tête. Faire passer ce tour derrière le talon, puis l'appliquer sur le dessus du pied, à la fois le bandage chevauchant le milieu au-dessus.



**Étape 3 :** Couper le bandage et appuyer légèrement pour le faire adhérer. Les surfaces adhésives postérieures du pied et/ou pas complètement recouvertes.



**Étape 4 :** Avec un chevauchement minimal, il reste assez de bandage pour épouser uniformément les contours, envelopper le bandage autour de la cheville et poursuivre l'application vers le haut de la jambe dans la direction déterminée par le rouleau. **REMARQUE :** L'application en tours individuels peut s'avérer nécessaire pour les jambes aux contours très prononcés.



**Étape 5 :** Le haut du bandage devant s'étaler juste sous le tibia du patient, à une distance de deux doigts de largeur sous le tibia l'arrière du genou. Faire passer de nouveau le bandage le long de la jambe de manière à couvrir toute la peau. Pour éliminer d'épouser une couche sans mousse que possible, essayer de minimiser le chevauchement du matériau.



**Étape 6 :** Une légère pression appliquée sur la fin du bandage permet de serrer en place pendant l'application de la couche de compression. On peut être temporairement l'adhésivité de la couche confort en mousse avec du ruban. **REMARQUE :** Si on doit inclure les orteils, appliquer la couche de compression uniquement après l'application complète sur les orteils (modifier le section « Application sur les orteils »).

#### 2<sup>e</sup> couche : Couche de compression

- Appliquer une compression uniforme à l'aide d'un moins deux couches. Le meilleur moyen d'obtenir une compression uniforme est d'appliquer le matériau à son plein étirement.
- Il est recommandé de tenir le rouleau près du membre pendant toute l'application pour obtenir une compression multilinéaire et uniforme.
- Si on remarque la présence de renflements après l'application, appliquer une autre couche de compression, jusqu'à ce que le membre semble lisse.



**Étape 7 :** Avec le pied en position de dorsiflexion (90°), appliquez le bandage en commençant à l'arrière de la base des orteils au niveau de la tête du crâne. Utilisez un rouleau de couche confort en mousse rigide pour obtenir un alignement exact et contrôlé du pied.



**Étape 8 :** Effectuer deux ou trois tours de haut autour de la cheville afin de bien couvrir le talon.



**Étape 9 :** Poursuivre l'application vers le haut de la jambe avec un chevauchement de 50 % et arrêter l'application à une distance d'environ 7,5 à 10 cm sous l'articulation de la couche confort en mousse. **REMARQUE :** Pour assurer la stabilité de l'application sur la jambe compliquée, le rouleau confort en mousse de la partie supérieure de la jambe doit être en contact avec la couche confort en mousse de la partie inférieure de la jambe.




**Étape 10 :** Au moment de terminer l'application, appliquer une légère pression et couper le surplus de matériau.

### Application sur le genou et au-dessus du genou

#### 1<sup>re</sup> couche :

##### Couche confort en mousse

- Placer le côté en mousse de cette couche contre la peau et la rendre juste assez pour épouser la forme de la jambe avec le moins de chevauchement possible.
- Recouvrir la peau avec une couche sans mousse que possible, sans laisser d'espaces.
- En présence de plaie ouverte (boursoite), utiliser des morceaux de couche confort en mousse rigides de manière que le côté en mousse soit à l'extérieur pour les séparer.




**Étape 11 :** Placer le patient en position debout. Le support seulement le talon de 5 cm permet de garantir le fixation du genou approprié.



**Étape 12 :** Découper une couche confort en mousse de 15 ou 20 cm, selon la taille du patient.



**Étape 13 :** Poser le bandage en utilisant la technique des « huit » autour du genou et poursuivre l'application vers le haut de la jambe de manière à obtenir au moins deux couches uniformes.



**Étape 14 :** Poursuivre l'application jusqu'au haut de la jambe. Maintenir le plus possible le chevauchement.



**Étape 15 :** Appliquer deux tours complets de couche confort en mousse sur le haut de la jambe pour empêcher le bord du bandage de s'étaler sur la tige. Au moment de terminer l'application, appliquer une légère pression et couper le surplus de matériau.

#### 2<sup>e</sup> couche : Couche de compression

- Appliquer une compression uniforme à l'aide d'un moins deux couches. Le meilleur moyen d'obtenir une compression uniforme est d'appliquer le matériau à son plein étirement.
- Il est recommandé de tenir le rouleau près du membre pendant toute l'application pour obtenir une compression multilinéaire et uniforme.
- Si on remarque la présence de renflements après l'application, appliquer une autre couche de compression, jusqu'à ce que le membre semble lisse.



**Étape 16 :** Commencer par deux tours complets de couche de compression de 15 cm autour de l'articulation du genou. Centre le bandage sur le tibia.



**Étape 17 :** Poursuivre vers la partie distale et s'assurer que le contact entre cette couche et la couche de compression de la partie inférieure de la jambe est adéquat.



**Étape 18 :** En utilisant la technique des « huit », recouvrir le genou et poursuivre l'application vers le haut de la jambe de manière à obtenir au moins deux couches uniformes.



**Étape 19 :** Arrêter l'application de la couche de compression au haut de la jambe. Faire une légère pression et couper le surplus de matériau.



**Étape 20 :** S'assurer que l'ensemble épouse bien les contours anatomiques.

### Choix de deux méthodes d'application sur les orteils

#### Méthode A Bandage individuel des orteils



**Étape A1 :** Placer une bande de couche confort en mousse sans chevauchement, puis la faire enrouler la couche à la partie distale de la partie distale.



**Étape A2 :** À l'aide de morceaux de couche de compression de 2,5 cm, envelopper chaque orteil individuellement en commençant par la partie distale. Appliquez les couches à leur plein étirement après le premier tour, en laissant des sections non étirées à 90°, après chaque tour semi-circulaire. Le rouleau est appliqué à la couche sans jointure. On obtient ainsi un manchon rigide offrant une pression contrôlable. Séquence : aller - appuyer et revenir - relâcher le rouleau.



**Étape A3 :** Enrouler le matériau et repasser l'application pour chaque orteil.



**Étape A4 :** Couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils et à l'aide d'un rouleau sans jointure, couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils sans jointure à leur plein étirement.



**Étape A5 :** Couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils avec la couche de compression en appliquant à son plein étirement selon la technique en accordéon, en faisant des tours semi-circulaires. Order de faire des tours complets autour des orteils.



**Étape A6 :** Une fois les orteils enveloppés, faire le bandage en faisant un tour complet autour du pied.



**Étape A7 :** Mouler l'ensemble à l'intérieur du pied.



**Étape A8 :** Une fois les orteils enveloppés, poursuivre l'application avec une couche de compression pour la jambe (consulter les étapes 7 à 10 de la section « Application sur le genou »).

#### Méthode B Bandage groupé des orteils



**Étape B1 :** Simple chaque espace interdigital avec des morceaux de couche confort en mousse double couche à la forme requise et moule de manière que le côté en mousse soit à l'extérieur.



**Étape B2 :** À l'aide d'une couche confort en mousse de 5 cm de largeur, faire un tour sans jointure appliqué sur les orteils et à l'aide d'un rouleau sans jointure, couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils.



**Étape B3 :** Couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils et à l'aide d'un rouleau sans jointure, couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils sans jointure à leur plein étirement.



**Étape B4 :** À l'aide d'une couche de compression de 5 cm, faire un tour sans jointure appliqué sur les orteils, des orteils jusqu'au talon. Couvrir les surfaces dorsales et latérales des orteils avec la couche de compression en appliquant à son plein étirement selon la technique en accordéon, en faisant des tours semi-circulaires. Order de faire des tours complets autour des orteils.



**Étape B5 :** Mouler l'ensemble à l'intérieur du pied.



**Étape B6 :** Une fois les orteils enveloppés, poursuivre l'application avec une couche de compression pour la jambe (consulter les étapes 7 à 10 de la section « Application sur le genou »).

### Retrait du bandage

Le haut d'application de la couche sur le haut des chevilles permet un retrait contrôlé et facile du bandage.



## ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 Pansement à barrière antimicrobienne

### Guide d'application



### Indications

ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 forment une couche agissant comme barrière antimicrobienne dont l'utilisation est indiquée sur des plaies d'épaisseur totale ou partielle telles que les brûlures, les zones receveuses de greffes, les plaies chirurgicales, les ulcères veineux de la jambe, les plaies de pression et les ulcères diabétiques.

ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 peuvent être utilisés sur des plaies infectées. Lorsque le produit est utilisé sur des plaies infectées, l'infection devrait être inspectée et traitée selon le protocole clinique en vigueur.

ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 peuvent être utilisés comme couche d'interface en association avec la thérapie par pression négative pendant un maximum de 3 jours.



### Mode d'emploi

**1** Retirer ACTICOAT Flex 3 ou ACTICOAT Flex 7 du sachet en utilisant une technique stérile.

**2** Tailler le pansement aux dimensions voulues si nécessaire. Lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une compressothérapie, le pansement doit être taillé aux dimensions de la plaie.



**3** Humecter le pansement selon le protocole clinique en vigueur, en le submergeant entièrement et en le pressant doucement (NE PAS utiliser de solution saline). Permettre à l'excès d'eau de s'égoutter avant l'utilisation.

Il est aussi possible d'appliquer une mince couche d'hydrogel, comme INTRASITE° Gel, directement sur la plaie et (ou) sur le pansement.


Changer le pansement en fonction de la quantité d'exsudat présent et de l'état de la plaie. Le pansement devrait être changé tous les 3 à 7 jours, selon la durée de port du pansement.

**4** Sans étirer le pansement, appliquer un côté sur la surface de la plaie et s'assurer qu'il n'y a pas de plis. Le pansement devrait être appliqué afin que la direction d'étirement soit positionnée le long du membre de manière à permettre le mouvement. ACTICOAT Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 peuvent être utilisés sur des plaies infectées.



**5** Fixer le pansement au moyen d'un pansement secondaire approprié qui permet de maintenir un milieu de plaie humide.

Dans le cas de plaies fortement exsudatives, il convient d'utiliser un pansement secondaire absorbant. Veiller à ce que le pansement reste humide, mais pas de manière à favoriser la macération des tissus.



## ACTICOAT<sup>®</sup> Flex 3 et ACTICOAT Flex 7 Contre-indications/Précautions

### Contre-indications

- Ne pas utiliser chez des patients présentant une sensibilité connue à l'argent.
- Ne pas utiliser chez un patient subissant un examen par imagerie par résonance magnétique.
- Retirer ACTICOAT Flex 3 ou ACTICOAT Flex 7 avant d'administrer des traitements de radiothérapie. Un nouveau pansement peut être appliqué après le traitement.
- Lors de l'utilisation d'ACTICOAT Flex 3 ou d'ACTICOAT Flex 7 sous compression, vérifier le système de pansement en entier régulièrement et ne le changer qu'en cas d'écoulement à travers le pansement. Un pansement absorbant non occlusif supplémentaire pourrait être nécessaire si l'exsudat est abondant.
- Si le pansement se dessèche ou adhère à la plaie, l'humecter ou le mouiller afin d'en faciliter le retrait et d'éviter de perturber la cicatrisation de la plaie.

### Précautions

- Pour usage externe seulement; par exemple, ne pas appliquer le pansement sur des organes exposés.
- ACTICOAT Flex n'est pas compatible avec des produits à base d'huile, tels que la gelée de pétrole.
- Éviter tout contact avec des électrodes ou des gels conducteurs pendant des mesures électroniques comme un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme.
- La couleur du produit peut varier. Cela n'a aucune incidence sur l'efficacité du pansement.
- Il se peut que le patient ressente une douleur passagère (ou des picotements) lors de l'application d'ACTICOAT Flex 3 ou d'ACTICOAT Flex 7. On peut réduire la douleur en suivant attentivement les instructions d'application. Si la douleur persiste après l'application, retirer le pansement et cesser l'utilisation.
- ACTICOAT Flex 3 ou ACTICOAT Flex 7 ne devrait être utilisé sur des bébés prématurés (moins de 37 semaines de gestation) que lorsque les bienfaits cliniques l'emportent sur les risques potentiels. On ne dispose d'aucune donnée clinique pour ce groupe d'âge, et peu de données sur l'utilisation chez les nouveau-nés sont disponibles.

Ligne clinique ouverte jour et nuit :  
1 800 463-7439

ACTICOAT Flex 3 		
Codes de commande	Dimensions	Boîte
66800396	5 cm x 5 cm	5
66800399	10 cm x 10 cm	12
66800409	10 cm x 20 cm	12
66800419	20 cm x 40 cm	6
66800432	40 cm x 40 cm	6
66800435	10 cm x 120 cm	6
66801290	4 cm x 15 cm	5
66801291	4 cm x 25 cm	5
66801292	4 cm x 35 cm	5

ACTICOAT Flex 7 		
Codes de commande	Dimensions	Boîte
66800395	5 cm x 5 cm	5
66800397	10 cm x 12,5 cm	5
66800420	15 cm x 15 cm	5
66800545	2,5 cm x 60 cm	5

## MAÎTRISEZ le risque d'infection

Smith & Nephew Inc.  
2280 Argente Road  
Mississauga, Ontario  
L5N 6H8 Canada

Tél. : 1 800 463-7439  
Téléc. : 1 800 671-9140

[www.smith-nephew.com/canada](http://www.smith-nephew.com/canada)

\* Marque de commerce de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew, juillet 2016

ACTC-AG-1607FR (CA5889)

Aux côtés des professionnels de santé depuis plus de 150 ans

## Mepilex Border Post-Op

### Pansement Post-Opératoire en chirurgie orthopédique



**Mepilex® Border Post-Op**  
AVEC TECHNOLOGIE SAFETAC®

### Pansement absorbant post-opératoire tout-en-un

Les quatre couches du pansement apportent les avantages suivants aux patients :

- 1 Augmente le confort
- 2 Le pansement peut demeurer en place jusqu' à un maximum de 7 jours ou lors du retrait des agrafes en post-op
- 3 Réduit la formation des phlyctènes
- 4 Facilite le retrait des agrafes
- 5 Permet de prendre une douche (pas un bain), « pansement imperméable »
- 6 Flexible et transparent
- 7 Optimisé pour l'absorption de sang

#### Technologie Safetac®

Moins de trauma.  
Moins de douleur.

Safetac® est une technologie brevetée d'induction de la silicone. Les pansements issus de la technologie Safetac® sont atraumatiques pendant le port et le retrait. Ils minimisent les traumas sur la plaie et la peau, ce qui réduit la douleur. Ils préviennent aussi la macération en formant un sceau sur la plaie, ce qui protège la zone péri-lésionnelle.



Arrachement de l'épiderme sous un adhésif traditionnel



Pas d'épiderme arraché sous Safetac®



Quantité de liquide acceptable.



Le pansement doit être changé lorsque les liquides atteignent les rebords.

**Mepilex® Border Post-Op sera retiré lors du retrait des agrafes, sauf si complication clinique.**

#### Application de Mepilex® Border Post Op



Nettoyer soigneusement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Ouvrir l'emballage stérile et retirer le pansement.  
Pour obtenir de meilleurs résultats, Mepilex® Border Post-Op doit chevaucher la plaie de 1 à 2 cm.



Ouvrir la partie la plus étroite du film et fixer Mepilex® Border Post-Op à la peau. Ne pas étirer. Retirer complètement la partie étroite du film et ensuite retirer le film plus large.



Fixer le pansement bien en place. Mepilex® Border Post-Op peut être laissé en place pendant plusieurs jours selon l'état de la plaie et la peau péri-lésionnelle, ou selon la pratique clinique acceptée.

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE

**MÖLNLYCKE®**  
HEALTH CARE

## GRM NON STANDARDISÉS (À VENIR)

GRM NON STANDARDISÉS (À VENIR)						
<b>ELASTIGRIP</b>						
Tailles	AL	TDB	LDDM	DS	SJ	ARG
C	42035235	42027285	42027285	42035235	42001880	42035235
D	42035236	42001881	42001881	42001881	42001881	42001881
E	42001882	42001882	42001882	42001882	42001882	42001882
F	42001883	42001883	42001883	42001883	42001883	42001883
G	42035238	42017397	42017397	42015621	42015621	42015621
<b>NITRATE D'ARGENT</b>						
AL	TDB	LDDM	DS	SJ	ARG	
42032328	42016728	42016728	42024785	42000964	42037126	
<b>IODOSORB</b>						
AL	TDB	LDDM	DS	SJ	ARG	
42032140	PHARMACIE	PHARMACIE	51000132	42010034	PHARMACIE	
<b>TELFA</b>						
Formats	AL	TDB	LDDM	DS	SJ	ARG
8,9 x 20,3cm	42024106	42024106	42024106	42024106	42024106	42024106
7,6 x 10,2cm	42004319	42004319	42004319	42024105	42004319	42004319
<b>OUATE ORTHOPÉDIQUE</b>						
Référez-vous au GRM de votre installation respective						